添付文書

取扱説明書

アルカリイオン整水器　家庭用

品番　TK8032

はじめに
取り付けと準備
ご使用の前に
使う
こんなときには
困ったとき
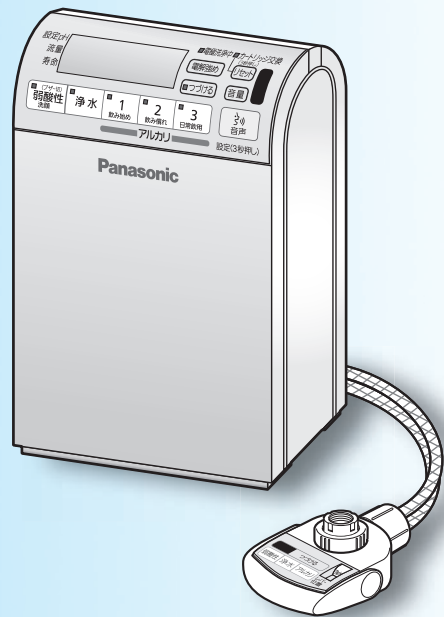
このアルカリイオン整水器の

交換用カートリッジは
品番：TK7415C1 です
●交換方法は ➡ 40ページ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■ 本器は、分岐水栓および給水コンセントによる取り付けはできません。
- ■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ■ **ご使用前に「安全上のご注意」（4～6ページ）を必ずお読みください。**
- ■ 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ■ 正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

保証書別添付

アルカリイオン整水器 なら
濁りやにおいをとり、おいしい水になります。

- 電気分解により、アルカリイオン水、弱酸性水を生成します。
- においや微細な濁りなどを除去し、おいしい水をつくります。
- 除去できる物質は、下記のJIS指定13品目です。

• 遊離残留塩素	• 濁り	
• 総トリハロメタン	• クロロホルム	• ブロモジクロロメタン
• ジブロモクロロメタン	• ブロモホルム	• テトラクロロエチレン
• トリクロロエチレン	• 1，1，1-トリクロロエタン	
• CAT（農薬）	• 2-MIB（カビ臭）	• 溶解性鉛

■アルカリイオン水の使用目的、効能・効果について

本器は医療用物質生成器として認証を受けており、使用目的、効能・効果は…

● 胃腸症状の改善です。

胃腸症状の改善とは：胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

※ 腎疾患（腎不全やカリウム排泄障害）の方は、アルカリイオン水を飲用しないでください。

本書では…

「アルカリイオン水」・「弱酸性水」の用語を使用しています。
これは JIS T 2004（家庭用電解水生成器）で示される「アルカリ性電解水」・「酸性電解水」のことです。

もくじ

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
（次は図記号の例です）

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

■ 分解したり、修理・改造しない

分解禁止

火災・感電の原因になります。

●修理は販売店にご相談ください。

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

禁　止

- ステープル(⋒)などで固定する
- 傷つける　• 加工する
- 無理に曲げる　• ねじる
- 引っ張る　• 熱器具に近づける
- 重いものを載せる　• 束ねる
- はさみ込む　• 踏みつける　など

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●電源プラグをコンセントから抜くときはコードを持たずプラグを持って抜いてください。

●コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

■ コイン形リチウム電池は乳幼児の手の届くところに置かない

禁　止

誤って飲み込むおそれがあります。

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■ 電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く

必ず守る

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V以外での使用はしない

禁　止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

ぬれ手禁止

感電の原因になります。

■ 飲用に合格した水(水道水など)以外には使用しない

禁　止

殺菌能力がなく、除去できる物質(2ページ参照)以外の有害物質は除去できないため、飲むと体調を損なう原因になります。

⚠警告

■ 電源プラグは、根元まで確実に差し込む

必ず守る

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ 本体を誤って水中に落としたときは、電源プラグをコンセントから抜き、引き上げる

必ず守る

感電の原因になります。

●修理は販売店にご相談ください。

⚠注意

■ 次の方はアルカリイオン水を飲む前に医師に相談する

必ず守る

●医師の治療を受けている方
●持病のある方、または身体の弱っている(異常を感じている)方
●腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方

体調を損なうことがあります。

■ アルカリイオン水を飲用して身体に異常を感じたとき、または飲用し続けても症状に改善が見られない場合は、使用を中止し、医師に相談する

必ず守る

体調を損なうことがあります。

■ 初めて飲む方は、「アルカリ1(飲み始め)」から少量(コップ1～2杯)ずつを2週間程度使用し、アルカリイオン水に慣れてから「アルカリ2(飲み慣れ)」、「アルカリ3(日常飲用)」を使用する

必ず守る

初めから強いアルカリを使用したり、多量に(コップ3杯以上)飲むと、体調を損なうことがあります。

■ 腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方はアルカリイオン水を飲用しない

禁　止

体調を損なうことがあります。

■ 医薬品をアルカリイオン水で服用しない

禁　止

体調を損なうことがあります。

■ pH10以上の水を直接飲まない

禁　止

体調を損なうことがあります。

●飲用にはpH9.5前後「アルカリ3(日常飲用)」をおすすめします。
また、1日あたりの飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

⚠注意

■ **次の方は弱酸性水を使用する前に、医師に相談する**

必ず守る

- ●肌の弱い方
- ●アレルギー体質の方

体調を損なうことがあります。

■ **次のような水は飲まない**

禁　止

- 弱酸性水
- 排水ホースから出る水
- 水質シグナル点滅中に吐水口から出る水

体調を損なうことがあります。

■ **アルカリイオン水や弱酸性水・浄水を魚などの飼育水に使用しない**

禁　止

環境が変わり、魚などが死ぬ原因になることがあります。

■ **指定のグリセロリン酸カルシウム製剤以外のものは入れない**

禁　止

体調を損なうことがあります。

●付属品または別売品（P-A5101）をお使いください。

■ **弱酸性水を使用して、肌に異常を感じたときは、使用を中止し、医師に相談する**

必ず守る

体調を損なうことがあります。

■ **本体側に60 ℃以上の熱水を通さない**

禁　止

やけどの原因になることがあります。

■ **アルカリに弱いアルミ製容器や、酸に弱い銅製容器などは使用しない**

禁　止

容器が変色したり、傷むことがあります。

■ **使い始めは本体内部の溜まり水を流す**

必ず守る

毎日の使い始めは	2日以上使用しないときは
約0.6リットル（約15秒間）通水後に使用する	約8リットル（約3分間）通水後に使用する

体調を損なうことがあります。

■ **アルカリイオン水や浄水をくみ置きする場合は、清潔な密閉容器に入れて、常温で1日以内、冷蔵庫に保存して2日以内に使う**

必ず守る

殺菌剤（カルキなど）が除去されているため、水が変質し、体調を損なうことがあります。

付属品

ご使用いただく前に次の付属品をお確かめください。
万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。

水切換レバー取り付け用	本体取り付け用	消耗品
水切換レバー ホースガイド付	**吸盤・取付板**(本体固定用)	**コイン形リチウム電池　CR2032** (リモコン用)
	吸盤(排水ホース用)	**グリセロリン酸カルシウム製剤** 〔6g入×1袋〕 (34ページ参照) 別売品品番：P-A5101 〔6g入×12本〕 ※別売品は、付属品(上図)とは、包装が異なります。
固定具セット	**ホース固定バンド**	**pH 試験液** 別売品品番：TK805003
	その他	
	●**カートリッジ品番ラベル**(19ページ参照)	

⚠注意

■ **付属品は乳幼児の手の届くところに置かない**

禁　止

誤って飲み込むおそれがあります。

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

■ **コイン形リチウム電池を火の中に入れたり、加熱したりしない**

禁　止

破裂して事故の原因になります。

お知らせ

●転居や水栓の取り替えなどで固定具が必要になった場合は、単品でご購入いただけます。(58ページ参照)

各部のなまえとご使用までの手順
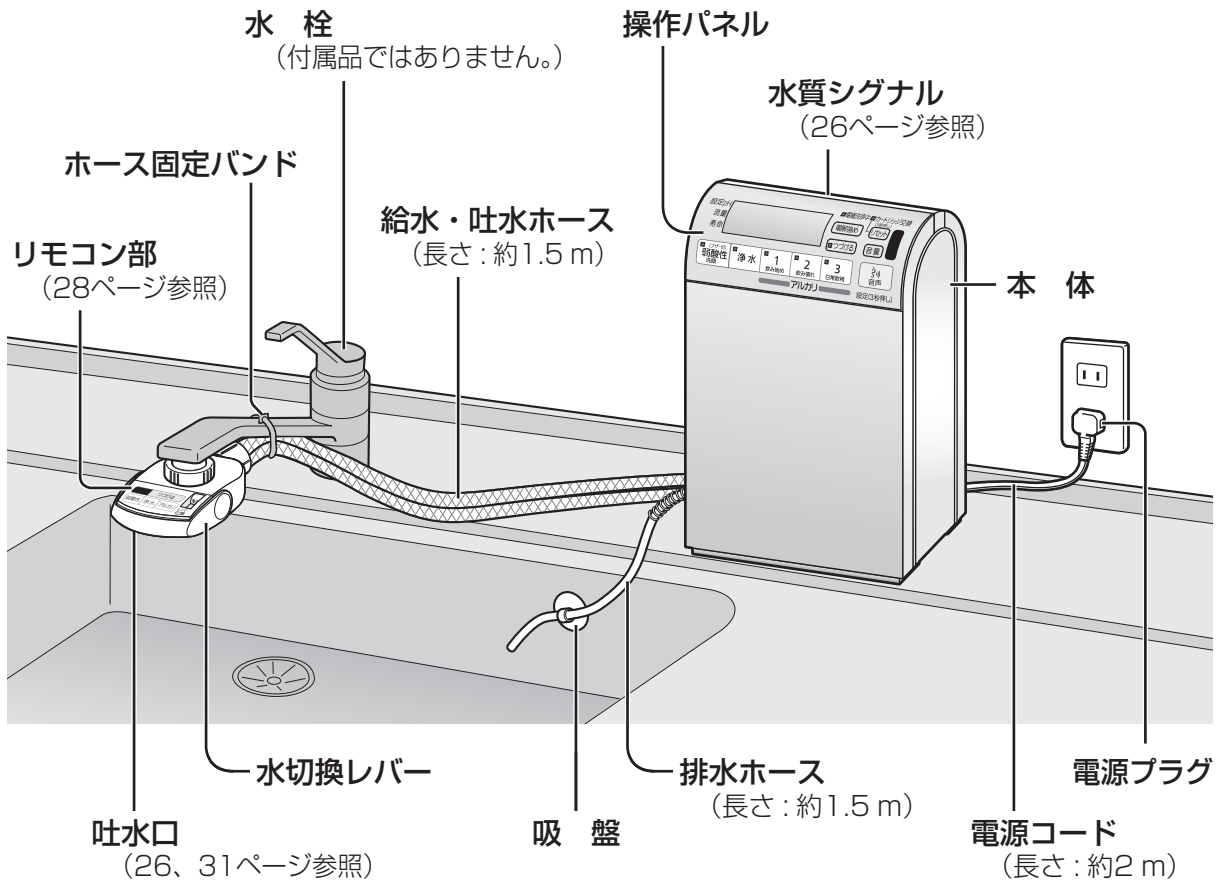
ご使用までの手順

1 水栓を確認する
（10〜11ページ参照）

2 水切換レバーを取り付ける
（12〜13ページ参照）

3 リモコン部に電池を入れる
（14〜15ページ参照）

4 本体を設置する
（16〜19ページ参照）

5 電源プラグを差し込む
（19ページ参照）

6 約3〜4分間アルカリイオン水を通水する
（本体内の空気抜きのため）
●水質シグナルが約20〜30秒間点滅後に点灯します。

7 水漏れがないか、また吐水口および排水ホースから水が出ているか確認する
（20〜21ページ参照）

8 pH（水素イオン濃度）を測定する
（22〜23ページ参照）

▼

使　う（26〜30ページ参照）

お知らせ

●pHを測定して、「pHの目安」の範囲内に入っていれば、グリセロリン酸カルシウム製剤を添加する必要はありません。（22、34ページ参照）

操作パネルのなまえとはたらき

■ 本体操作パネル

表示部(液晶表示)
下記を表示します。
- 各水質切替ボタンの設定pH
  (25ページ参照)
- 通水の流量(29ページ参照)
- カートリッジ寿命(38ページ参照)
- 本体の異常(43、44ページ参照)

など

電極洗浄中ランプ(赤色)
自動洗浄中に点灯します。
(35ページ参照)

カートリッジ交換ランプ(赤色)
交換の時期をお知らせします。
(38ページ参照)

リセットボタン
カートリッジを交換した後に押します。
(41ページ参照)

リモコン赤外線受信部

音量ボタン
音声ガイドの音量を切り替えます。
(33ページ参照)

音声ボタン
音声ガイドの聞き直しや設定をします。
(25、32ページ参照)

設定pH
流量
寿命
□電極洗浄中 □カートリッジ交換
(3秒押し)
電解強め
リセット
□つづける
音量
□(ブザー切) 弱酸性 洗顔
□ 浄水
□ 1 飲み始め
□ 2 飲み慣れ
□ 3 日常飲用
アルカリ
音声
設定(3秒押し)

水質切替ボタン
水質の切り替えをします。(26ページ参照)

水質表示ランプ
選んだ水質が点灯します。(26ページ参照)

電解強めボタン
電解を強めに設定します。(30ページ参照)

つづけるボタン・ランプ(黄緑色)
同じ水質をつづけて使うときに押します。
(26、27ページ参照)

■ リモコン部操作パネル

水栓を確認する

水切換レバーを取り付ける前に、お使いの水栓を確認してください。

取り付けできる水栓
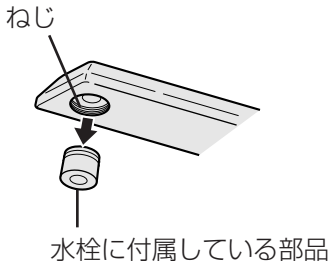
お使いの水栓が、下記の条件にあてはまる場合は、本器の付属品(固定具セット)で、水切換レバーが取り付けられます。(取り付けかたは12〜13ページ)

お知らせ

- 先端部分がプラスチック製のもの(断熱キャップ付)では、取り付け部より水漏れする場合があります。

「内側にねじがある水栓」または「大型の水栓(先端径：24 mm～32 mm)」をお使いの場合は、
水切換レバーの取り付けに、下記の別売品が必要です。

別売品を使用して取り付けできる水栓		必要な別売品
内側にねじがある	ねじ 水栓に付属している部品	**泡沫水栓用つぎて(内ねじ用)** ● 品番：PRV-D8623K〔W23, 山20〕 ● 品番：PRV-D8623M〔W24, 山20〕 ● 品番：PRV-D8623G〔M24, ピッチ1 mm〕 ※水栓メーカー・品番をご確認のうえ、販売店にご相談ください。
大型	**水栓先端径：24 mm～32 mm**	**大型水栓用金具** ● 品番：P-06JR (内径32.5 mm)
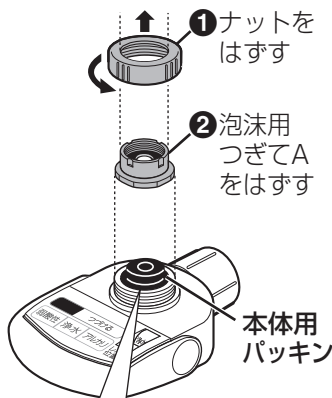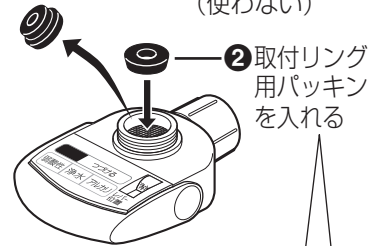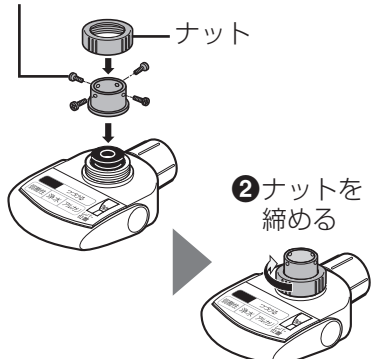
取り付けできない水栓

下記のような水栓をお使いの場合、水切換レバーは取り付けられません。
また、分岐水栓および給水コンセントによる取り付けはできません。

● そのほかにも変形水栓や、ねじ径(22 mm以外)やパイプ径の違うものがありますので、ご注意ください。

水切換レバーを取り付ける

使わない部品は、転居時や水栓の取り替えなどにそなえ、保存しておいてください。

水栓の形状	使用する固定具	1 水切換レバーの分解	2 水切換レバーの取り付け

外側にねじがある

水栓の形状：ねじ径22 mm

使用する固定具

泡沫用つぎてA
（水切換レバーに装着済み）
泡沫用パッキン付

または

泡沫用つぎてB
泡沫用パッキン付

1 水切換レバーの分解

●はずれたときは元に戻す

2 水切換レバーの取り付け

❶泡沫金具をはずす

先がふくらんでいる

水栓の形状

パイプ径 16 mm

パイプ径 19 mm

使用する固定具

取付リング（小・白）

取付リング用パッキン

取付リング（大・ベージュ）

2 水切換レバーの取り付け

※泡沫用つぎては使いません。

取付リング用パッキンは番号があるほうを下にする

先がふくらんでいる・ストレート型

水栓の形状

パイプ径 16 mm・19 mm 以外

水栓先端径 13 mm～24 mm 未満

使用する固定具

取付金具（ねじ4本付）

2 水切換レバーの取り付け

※泡沫用つぎては使いません。

❶取付金具のねじ（4本）をはずす

❷ナットを締める

※水栓に合ったつぎてを選ぶめやす

AまたはBの表示があります

適合水栓

つぎてA：W22・山20（水切換レバーの装着品）
TOTO・INAX・MYM・KVK・カクダイ・ミズタニ 製の水栓などに

つぎてB：M22・ピッチ1 mm（本器の付属品）
YANMAR・GROHE・MOEN製 の水栓などに

水栓メーカーが分からない場合は、つぎての泡沫用パッキンをはずし、**「軽く回して根元まで締まる方」**を選んでください。取り付けるときは泡沫用パッキンをもとに戻してください。

パナソニックのホームページ http://panasonic.jp/alkaline/toritsuke/ で、取り付けを実演した動画をご覧いただけます。（2009年1月現在）

お願い ●ナットの締めつけには、工具を使わないでください。（ナット破損の原因）

❷水栓に合ったつぎて（AまたはB）を選んでください。
（12ページ下参照）

●**泡沫用つぎてから水が漏れる場合**
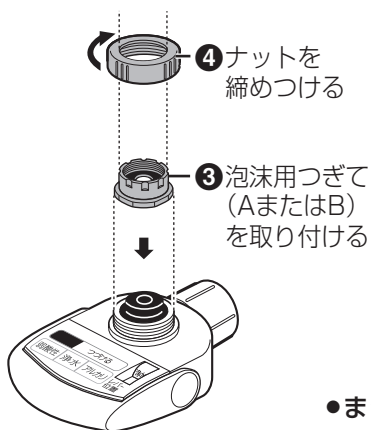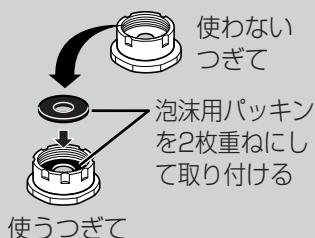
●**まっすぐに強く、ねじ込んでください。**
（ななめにねじ込むと、泡沫用つぎてのねじ山がつぶれ、水漏れの原因）
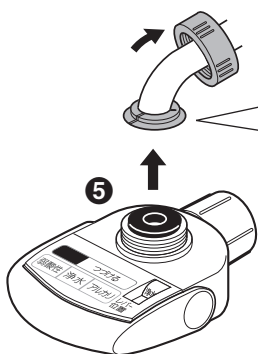
❹取付リングを取り付ける（小 または 大 を使用）

切れ目のない部分を水栓のふくらみに当てる

切れ目部分を押し込む
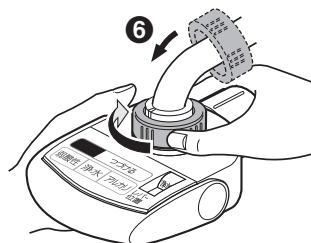
●**取付リングがうまく取り付かない場合**や**水が漏れる場合**は、付属の**取付金具**で取り付けてください。（下記参照）
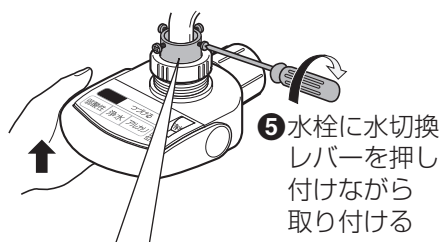
水切換レバーを取り付ける

電池を入れる(交換する)

1 水切換レバーから リモコン部を取りはずす

●水切換レバーは「ストレート」の位置(下側)にしてください。
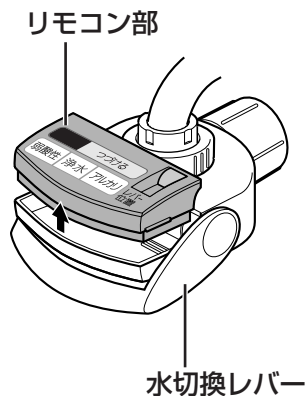
2 電池ケースの フタを取りはずす

●フタを取りはずす前に、水けをふき取ってください。
●フタの溝にメダル状のものを差し込んで、左に回してください。

リモコン部裏面
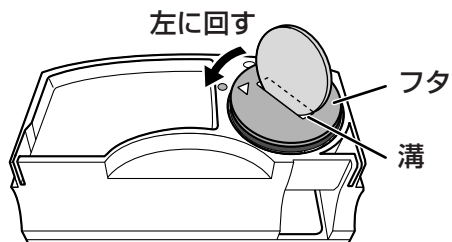
5 リモコン部の 動作を確認する

●水質切替ボタンを押し、赤外線送信部が点灯するか確認してください。(押すたびに1回点灯します。)
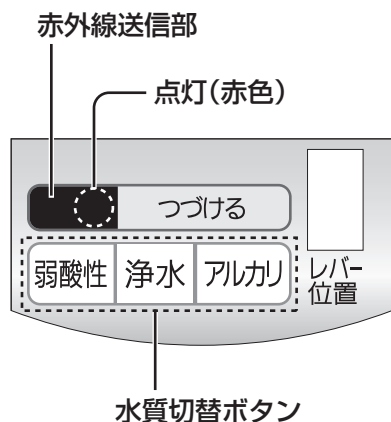
6 水切換レバーに リモコン部を取り付ける

3 電池を入れる

- 交換のときは、古い電池を取り出してください。
- 「＋」を上にして入れてください。
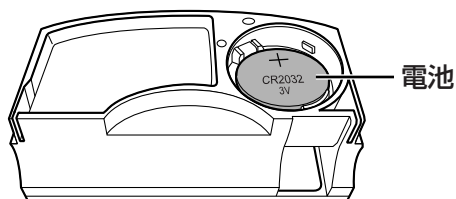
4 電池ケースに フタを取り付ける

- フタの溝にメダル状のものを差し込んで、右に回してください。
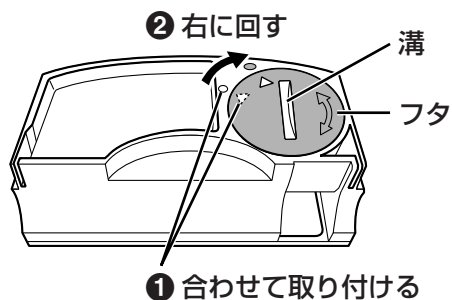
⚠ 注意

■ コイン形リチウム電池の＋と－は正しく入れる

必ず守る

＋と－を間違えて入れると、破裂や液漏れによる事故の原因になることがあります。

■ コイン形リチウム電池や電池ケースの内部をぬらさない

水ぬれ禁止

破裂や液漏れによる事故の原因になることがあります。

お願い

- 赤外線送信部が点灯しなくなったら、電池を交換してください。
  ※ 電池交換の目安は約1年です。（1日20回操作した場合）
- 電池を交換するときは、**「コイン形リチウム電池 CR2032」**をお使いください。
- **使用済みの電池は、地域で定められた条例に従って廃棄してください。**
- リモコン部を、水切換レバーから取りはずした状態で使用しないでください。

お知らせ

- 付属の電池は、テスト用のため寿命が短い場合があります。

本体を設置する

設置上のお願い

■次のような場所には、設置しないでください。（故障の原因）

- 火を使用しているところ、その他の高温部（60℃以上）の近く
- 直射日光のあたるところ
- 屋外や風雨にさらされるところ
- キッチンカウンターより低いところ（足元など）
- 油が付着するところ
- 浴室や水・蒸気のかかるところ
- 凍結の可能性のあるところ　など

お知らせ

- 本器の近くでは、ラジオに雑音が入ることがあります。そのときは、ラジオを本器から離してください。
- **次のような場所では、リモコンの赤外線が影響を受け、動作しにくい場合があります。そのときは、本体のリモコン赤外線受信部を水切換レバーのほうへ向けると、動作しやすくなります。**
  - IH調理器（炊飯器やクッキングヒーター）の近く
  - 黒っぽい天井や高い天井（吹き抜けなど）の下
  - 本体の真上に障害物（戸棚など）がある
  - インバーター式蛍光灯の真下
  - リモコン赤外線受信部に、強い光が当たる場所

■水の出口を市販のホースなどで延長しないでください。（故障の原因）

- 付属の排水ホース（長さ 約1.5 m）では長さが足りないときは、別売品の「排水ホース（長さ 2.5 m）」をお使いください。（58ページ参照）

■お湯専用の水栓には取り付けないでください。（故障の原因）

⚠注意

■ 本体は平らな場所に設置する

不安定な状態で設置すると転倒し、けがをすることがあります。

■ 本体を壁に掛けて使用する場合の設置は、必ず販売店または工事店に依頼する

ご自分で設置すると、落下して、事故の原因になることがあります。

- 壁掛けセットは、57ページ「別売品」を参照してください。

■ 給水・吐水ホースに他の器具を接続しない

付属の水切換レバー以外を接続すると、水漏れや故障の原因になることがあります。

■ 水の出口をふさいだり、ホースを折り曲げたり、ねじったり、つぶしたりしない

水漏れや適切なpHの水が出なくなる原因や故障の原因になることがあります。

■ 逆止弁（水の逆流防止弁）の付いていない給湯設備に接続しない

給湯設備が故障する原因になることがあります。

■ 元止式湯沸器（湯の出口で止水できない構造のもの）に接続しない〔瞬間湯沸器など〕

湯沸器が故障する原因になることがあります。

準 備

1 設置場所に合わせて、電源コード・ホースを引き出す

●つぶれたり、折れたりしないようにしてください。

左側から引き出す場合
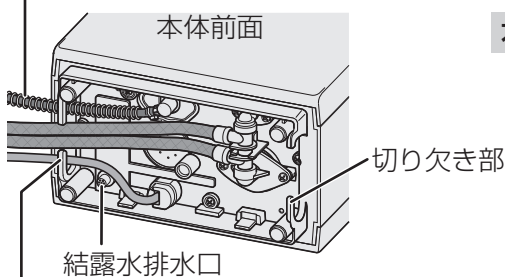
本体底面

右側から引き出す場合
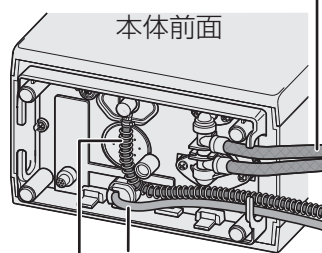
2 設置場所に本体を置いて電源プラグを差し込み、リモコンの動作確認をする

●リモコン部の水質切替ボタンを押し、本体側でその水質の水質表示ランプが点灯するか確認してください。（動作しない場合は、本体の設置位置を変更してください。）
●動作確認後、電源プラグを抜いてください。

3 本体底面に、付属の吸盤を取り付ける
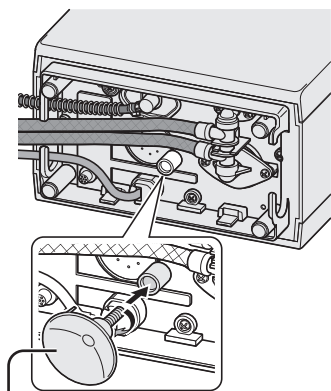
●かるく止まるまでねじ込んでください。

4 転倒防止のため吸盤でしっかり固定する

●設置位置の汚れや水けを十分にふき取ってください。
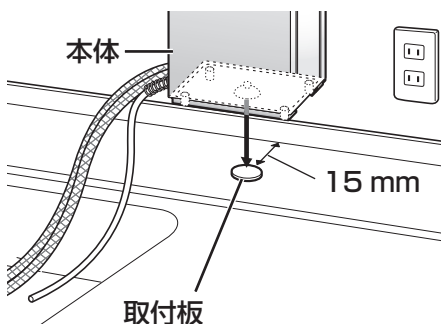
●吸盤が付かない場合は、付属の取付板の台紙をはがしてはり、その上に本体を固定してください。

●お手入れなどで本体を移動するときは、本体を傾け吸盤の端をつまようじなどで押し込んで、吸盤を取りはずしてください。

本体を設置する（つづき）

1 準備ができたら 給水・吐水ホースを接続する

❶ ホース締付ナットとホースガイドを水切換レバーから はずし、**ホースガイドの表示(白・黒)に合わせて** 給水・吐水ホースに通す

吐水側（断面：**白**）

給水側（断面：**黒**）

❷ 給水・吐水ホースを、奥まで差し込む

良い例	悪い例
	すきま

❸ ホースガイドを押し込む

5 mm以下
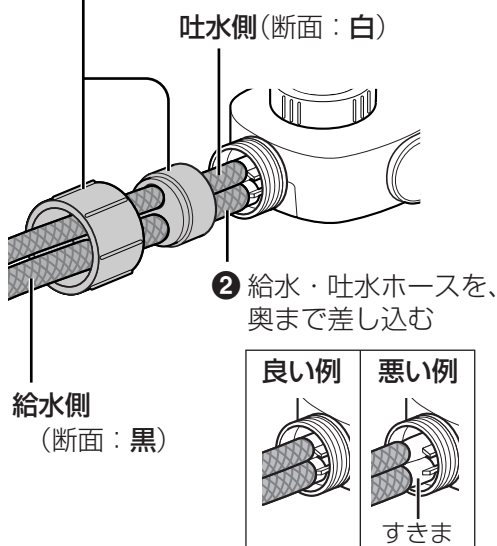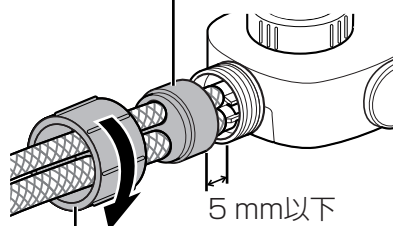
❹ ホース締付ナットで確実に締めつける

●工具を使わないでください。（ホース締付ナット破損の原因）

ホースについて

●長すぎる場合は、切って使用してください。（切るときは、切断面を平らにしてください。）

●束ねないでください。また、浮かないように固定してください。（ホース内に水が残り、においの原因）

●**給水･吐水ホースは､キッチンカウンターより低いところを通らないようにしてください。**（ホース内に水が残り、においの原因）

3 排水ホースを吸盤で固定する

●排水ホースの下に、くず入れなどを置かないでください。
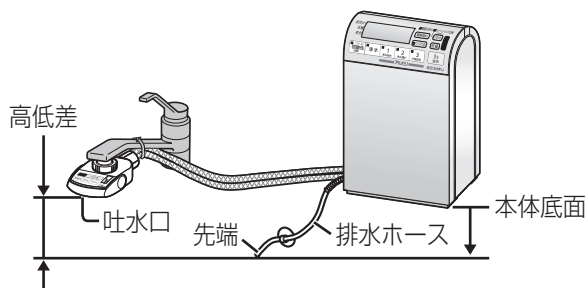
吐水口と排水ホース先端の高低差は
20 cm以上50 cm未満に
また、排水ホース先端は、本体底面より**10 cm以上低く**
〔適切なpH(水素イオン濃度)を得るため〕

2 ホース固定バンドで 給水・吐水ホースを固定する

●給水・吐水ホースは必ず固定してください。(水漏れの原因)
※ 固定するとき、ホースをつぶさないようにしてください。

●**ホースはできるだけ、短く、まっすぐにしてください。**
(捨て水が少なくなり、節水できます。)

水質シグナル
●高い位置や強い光が当たるところでは、見えにくくなります。
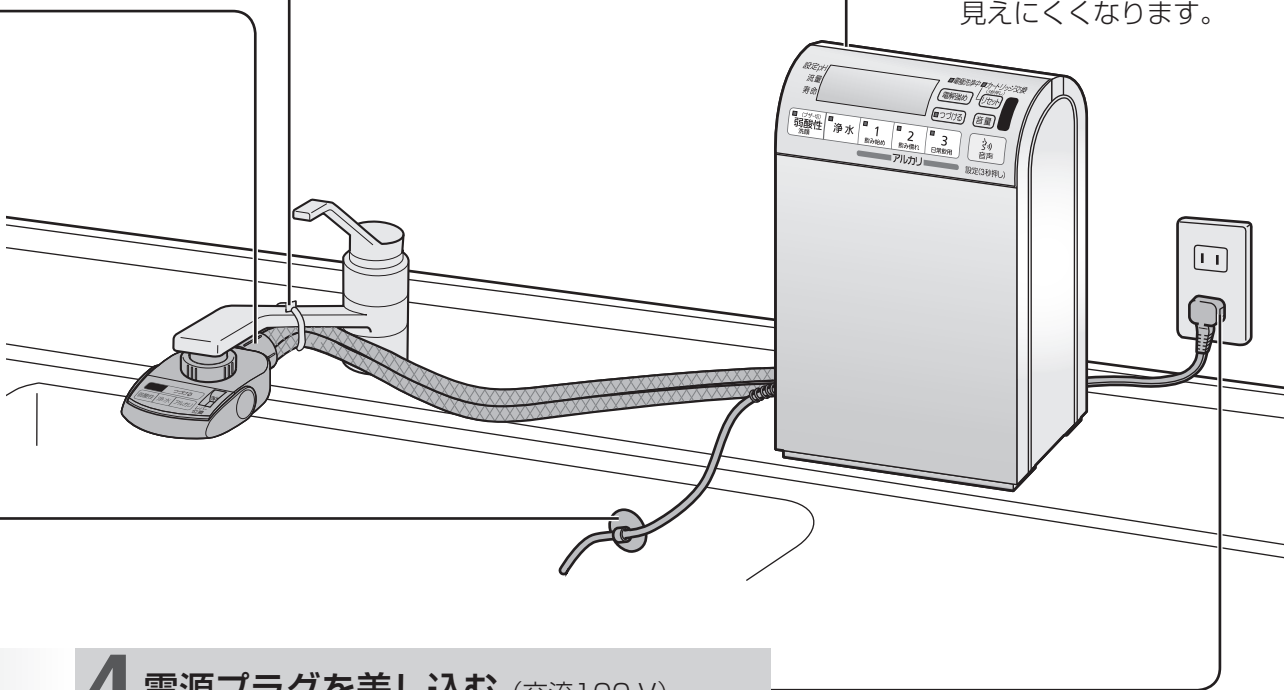
4 電源プラグを差し込む (交流100 V)

●ブザーが「ピッ」と鳴り、「浄水」の水質表示ランプが点灯します。
●待機時も約0.4 Wの電力を消費しています。

お願い

●**電源コードを床にはわせないでください。**
(破損の原因)
●**本体を倒した状態で設置しないでください。**
(故障の原因)
●**設置後、3~4分間アルカリイオン水を通水し、本体の空気抜きをしてください。**(26ページ参照)
●自動洗浄を機能させるため、またカートリッジ寿命を正しく表示させるため、通常は電源プラグを抜かないでください。(35、38ページ参照)
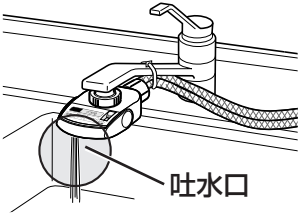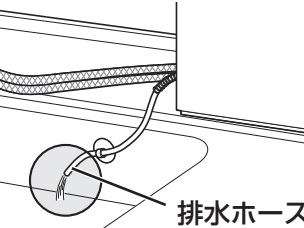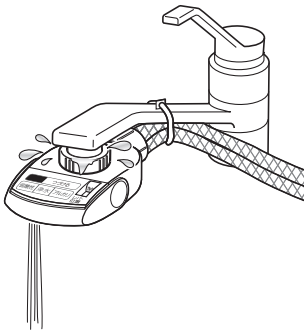
お知らせ

●**カートリッジ品番ラベル**(付属品)に必要事項を記入し、本体の見やすい位置にはってください。
交換用カートリッジを購入するとき、品番の確認に便利です。
●ホースの長さがたりないときは、別売品のホースをお使いください。(57、58ページ参照)
●設置直後は、通水すると水質シグナルが約20~30秒間点滅後、点灯に変わります。(8ページ参照)

設置後の確認

設置後、通水して下記の項目を確認し、異常がある場合は各々の処置をしてください。

確認項目	異常時の点検個所と処置	参照ページ
吐水口から水が出ているか	●給水・吐水ホースが折れたり、つぶれたりしていないか ➡まっすぐにしてください。	17 18 19
アルカリイオン水を通水したとき、排水ホースから水が出ているか	●排水ホースが折れたり、つぶれたりしていないか ➡まっすぐにしてください。 ※通水中に、排水ホースから出ている水がとぎれる場合は、吐水口と排水ホース先端の高低差を大きくしてください。	17 18 19
水切換レバー接続部に水漏れがないか	●水切換レバーを水栓に確実に取り付けているか ➡「水切換レバーを取り付ける」を再確認し、確実に取り付けてください。 ※泡沫用つぎての締めつけが弱いときは、給水・吐水ホースをいったん取りはずし、水切換レバーごと回転させると、しっかり締めつけられます。 ●水切換レバー内の部品は正しく入っているか ➡部品を正しく取り付けてください。	12 13
	●水栓の先端（断熱キャップなど）にひび割れがないか ➡水道工事店にご相談ください。	—

確認項目		異常時の点検個所と処置	参照ページ
給水・吐水ホース接続部に水漏れがないか	••••	●給水・吐水ホースを水切換レバーに確実に取り付けているか ➡奥まで差し込み、ホース締付ナットで締めつけてください。	18
水栓から水漏れがないか	••••	●水栓のパッキンが古くなっていないか ➡水道工事店にご相談ください。 ●水栓(断熱キャップなど)にひび割れがないか ➡水道工事店にご相談ください。	—
リモコンを操作し、本体が正しく動作するか	••••	●本体のリモコン赤外線受信部がかくれていないか ➡リモコン赤外線受信部がかくれないよう、本体の向きを変えてください。	—
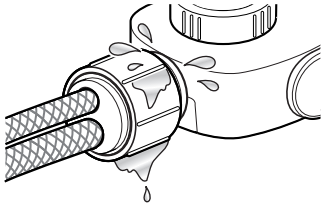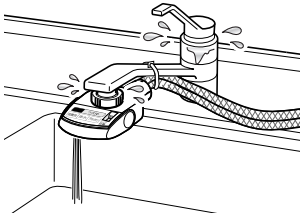
pH(水素イオン濃度)を測定する

設置後および長期間(目安：約1週間以上)使用しなかった場合は、必ずpHを測定し、「pHの目安」の範囲内に入っているか確認してからご使用ください。
その後も、定期的に(1カ月に1回以上)測定してください。

準備するもの：pH試験液(付属品)

■ 測定のしかた

1 pH 試験液を
試験カップに2滴落とす

- 2滴以外では正確に測定できません。
- 試験水を採水したあとpH試験液を落とすと、試験水と混ざらず、正確に測定できません。

2 生成水(アルカリイオン水または弱酸性水)を
約10秒以上流す
(安定したpHを測るため)

3 試験カップに
試験水を入れる

- 試験水をあらかじめコップなどに採水し試験カップに入れると、カップラインに合わせやすくなります。
- 入れる量は、カップラインの上下約5 mm の範囲であれば、問題なく判定できますので、ラインに合わなくても、やり直す必要はありません。

カップラインまで入れる

4 明るいところで
pH測定表と比較する

- **時間が経過すると試験水の色が変化します。時間を置かずにpH測定表と比較してください。**

⚠注意

■ pH試験液は、火気に近づけない

引火し、火災の原因になることがあります。

■ pH試験液や試験液の入った水は、飲んだり、目に入れたりしない
(特にお子様にはご注意ください。)

体調を損なうことがあります。

- もし誤って飲んだ場合は水を多量に飲み、目に入れた場合は十分に水洗いをし、医師に相談してください。
- 必ずフタをして、乳幼児の手の届かないところに保管してください。

	pHの目安
アルカリ3	9〜10
アルカリ2	8.5〜9.5
アルカリ1	8〜9
弱 酸 性	5〜6.5

お願い

- 市販のリトマス試験紙などでは正確に測定できません。必ずpH試験液で測定してください。
- pH試験液の原液を捨てるときは、水で薄めて下水に流してください。
- pH試験液やpH測定表は日光に当てると変色しますので、暗いところに保管してください。

お知らせ

- このpH試験液は、pHの目安を測るためのものです。
  また、pH4.0以下の酸性水は同じ色になります。
  ※ 試験液の主な成分は、エタノール、メチルレッド、ブロモチモールブルー、フェノールフタレインです。
- 水質により、生成水のpHが「pHの目安」の範囲に入らない、またはアルカリイオン水がアルカリ性を示さない（青や紺の液が、緑や黄色に変色する）場合があります。そのときは、以下の処置をしてください。
  ①電解の強さを「強（強め）」に設定する（30ページ参照）
  ②グリセロリン酸カルシウム製剤を添加する（34ページ参照）
  ※また、原水を測定した場合、試験水の色がpH測定表と異なることがあります。
  （水中の炭酸や各種成分の影響）
- pHが高い場合は、弱いアルカリに水質を切り替えたり、浄水を混ぜてお使いください。
- **カートリッジが新しいとき（約1週間）は、pHがやや高くなることがありますが、異常ではありません。**

ご使用上のお願い

■ 本体を倒した状態で使用しないでください。
（故障の原因）

■ 濁りのひどい水や赤サビの多い水は、通水しないでください。
（カートリッジ寿命が短くなる原因）
- 毎日1回、本体に通水する前に、原水をしばらく流してください。

■ アルカリイオン水または弱酸性水を、連続して30分以上使用しないでください。
30分以上使用すると、液晶表示に「U27」（43ページ参照）を表示し、電気分解を中止します。

■ 海水などの塩分を含んだ井戸水（海岸近くの井戸水）は、通水しないでください。
（故障の原因）

■ 地域・水質によっては、指定のpHが得られないことがあります。特に地下水を水源とした地域では、設置前に酸度測定試薬（品番：PJW-T8667）による酸度の測定を販売店にご相談ください。

■ 水質の※硬度が高い地域で使用するときは…
- 毎日1回、使用する前に約1分間、弱酸性水を通水してください。
  （吐水口や通水路にカルシウムが付着し、水の出が悪くなるため）

※硬度が高い地域では、石けんの泡立ちが悪かったり、やかんや鍋などに白いもの（カルシウム）が付着します。

ご使用の前に

上手にお使いいただくために（用途に合わせてお使いください。）

アルカリイオン水は

- 「アルカリ1」→「アルカリ2」→「アルカリ3」の順に、pHが約0.5程度高くなります。
- 1日あたりの飲用量は、「アルカリ3」で0.5リットルから1リットルを目安にしてください。

	用　途		pHの目安
□ 3 日常飲用	日常飲用	コーヒー・紅茶・緑茶・煮物・鍋物・汁物 などに	9〜10
□ 2 飲み慣れ	飲み慣れ	お米を炊くとき	8.5〜9.5
□ 1 飲み始め	飲み始め	アルカリイオン水を初めて飲むとき（2週間程度）	8〜9
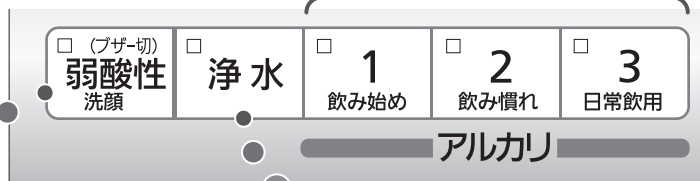
弱酸性水は

- 肌に近い弱酸性の水です。

用　途　洗　顔

pHの目安　5〜6.5

浄水は

- ろ過された不純物の少ない水です。

用　途　薬・ミルク

（薬の服用時やミルクの溶き水・飲用などに）

電気分解はされていません

- **アルカリイオン水でお米を炊くときは**
  アルカリイオン水のpHが高くなるほど、ご飯がやわらかめになります。お好みに合わせて水量やアルカリレベルを調整してください。（おすすめ：pH9.0以下）
- **pH（水素イオン濃度）とは**
  水（水溶液）のアルカリ性・中性・酸性の程度を示すもので、水素イオン指数のことです。

使用中の液晶表示について

使 用 中

（例）アルカリ3の場合

飲用しない水（「準備中」の水・弱酸性水など）が出ているときは、飲用外 と表示

設定pH ◀ 飲用 目安 9.5 親切
流量
寿命

水質切替ボタンに設定されているpH（目安）を表示

※浄水のときは「- - -」と表示

水栓を閉めると…

待 機 状 態

カートリッジ寿命を表示
（38ページ参照）

（例）

お知らせ

- 液晶表示は、ボタン操作が終わってから、または水栓を閉めてから、約30秒後に消えます。（節電のため）
  ボタン操作をする、または本体に通水すると、点灯します。
- 流量が低下（約1.0 L/分未満）すると、通水中でもカートリッジ寿命を表示します。
  この場合、電気分解（電解・生成）していません。

音声ガイドについて

ボタン操作の内容や本体の異常などを、音声でお知らせします。
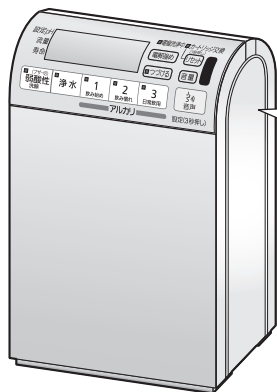
音声ガイドの例

- 3 日常飲用 を押すと
  音 声 「アルカリ3です」
- 〔水栓絞る〕の表示が出たとき （29ページ参照）
  音 声 「水量が出すぎています　水栓を絞ってください」
- 異常表示が出たとき （43、44ページ参照）
  音 声 「異常が発生しました
  電源プラグを抜いて販売店に相談してください」

お知らせ

- 音声 を押すと、音声ガイドをもう一度聞くことができます。
- 音声ガイドは、「親切」･「通常（「親切」モード解除）」･「切」のモード設定ができます。（32ページ参照）
- 音声ガイドの音量は、「3（大）」･「2（中）」･「1（小）」の 3段階に調節できます。（33ページ参照）

使いかた

アルカリ・弱酸性・浄水を使う

1 水切換レバーを「浄水」に切り替える

※ 使用できる水温は35 ℃未満です。
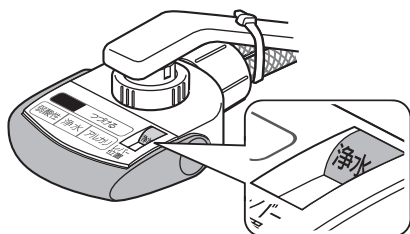
2 使用する水質切替ボタンを押す

● ブザーが「ピッ」と鳴り、**水質表示ランプ**が点灯します。

3 水栓を開ける

● 水質シグナルが点滅します。

水質切替ボタン	用　途	水質シグナルの色
3 日常飲用	日常飲用	ブルー
2 飲み慣れ	飲み慣れ	
1 飲み始め	飲み始め	
浄水	———	グリーン
(ブザー切) 弱酸性 洗顔	洗　顔	ピンク

1

2

3

4

つづけるボタン・ランプ

水質表示ランプ

水質シグナル

原水口（ストレート）

排水ホース

吐水口
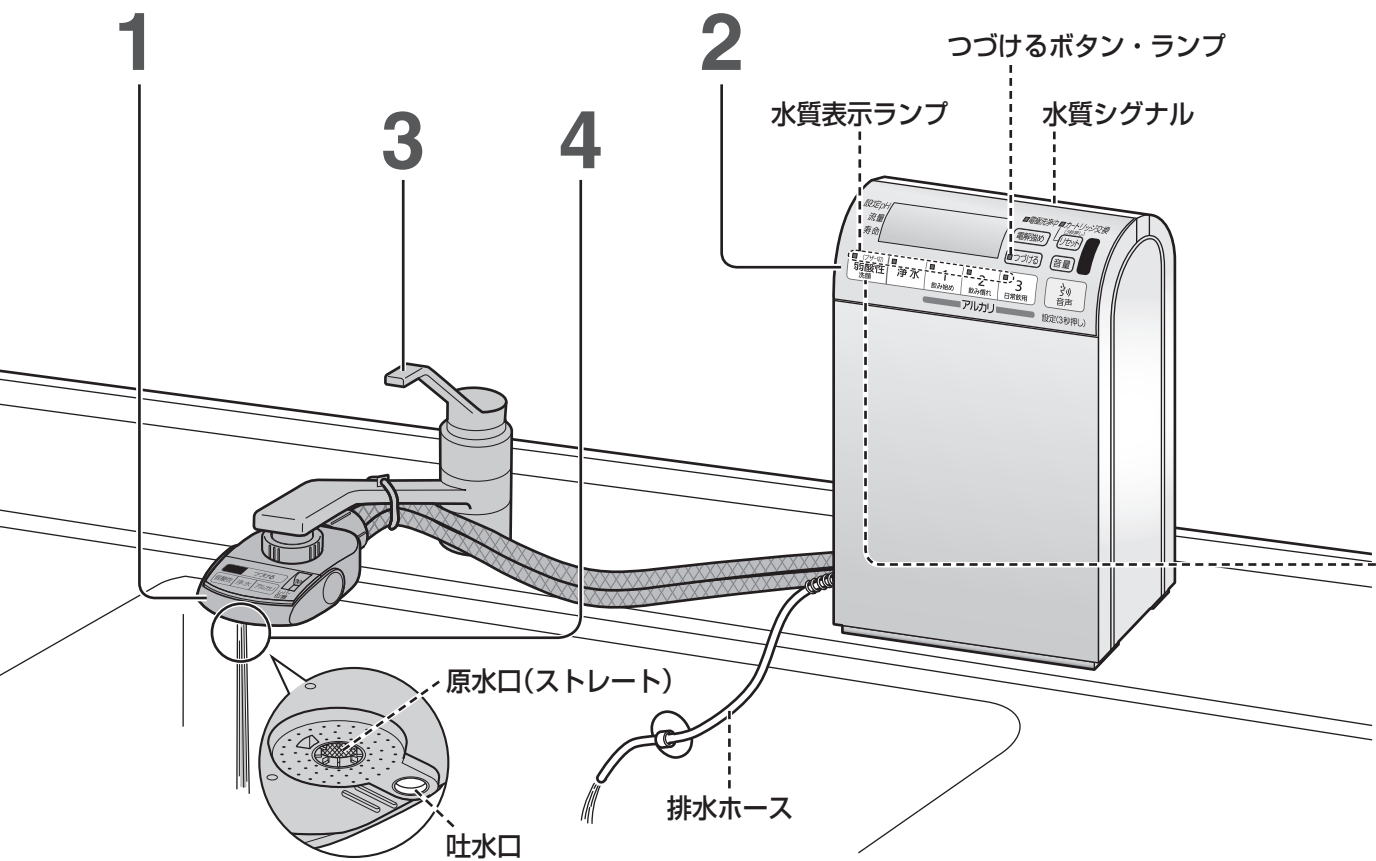
● アルカリイオン水・弱酸性水・浄水が出ます。

4 使　う

● **水質シグナルが点灯し、ブザーが「ピッピッピッ」と3回鳴ると使用できます。**

※まちがって飲用しないよう、弱酸性水使用中は警告のブザーが鳴り続けます。**（弱酸性ブザー）**

アルカリイオン水使用中は

排水ホースから酸性水が出ます。

浄水使用中は	弱酸性水使用中は
排水ホースから浄水が出ます。（飲用ではありません。）	排水ホースからアルカリイオン水が出ます。（飲用ではありません。）

つづけるボタンについて　□つづける

同じ水質をつづけて使うときに便利です。

例えば
- **お米をとぐとき**
- **コップに注いで何杯か飲むとき　などに**

使用する水質切替ボタン（「アルカリ」または「浄水」）を押した後、□つづける を押す（つづけるランプ点灯）
点灯中は、水栓を一度閉めて再度開けるとすぐに使用できます。

- **弱酸性では、つづけるボタンは使用できません。**
- つづけるランプは、「アルカリ」↔「浄水」を切り替えたとき、または水栓を閉めてから約10分後に消灯します。

弱酸性ブザーをとめるには…

を押す

※再度、弱酸性水を使用すると、ブザーが鳴ります。

■ 弱酸性ブザーを鳴らしたくないときは…

下記の設定をしてください。（通水中は設定できません。）

内　容	操作のしかた
弱酸性ブザーONを解除する	□（ブザー切）弱酸性 洗顔 を「ピー」と鳴るまで押す（約3秒間）
ONに設定する	□（ブザー切）弱酸性 洗顔 を「ピッ…」と4回鳴るまで押す（約3秒間）

使用後、水栓を閉めると…

- 弱酸性を使用したときは、水質が「浄水」に自動的に切り替わります。
- 排水ホースから約90秒間水が出ます。（電極自動洗浄または本体内の水抜きのため）

お知らせ

- 使用中に排水ホースから出る水は、ためて洗い物やお風呂などにお使いください。
  - ※ 排水を容器などにためる場合は、容器の水面が本体底面より高い位置にならないようにしてください。また、排水ホースの先端部分は、水面から離してください。（18ページ参照）
  - ※ 洗い物のすすぎには使用しないでください。
  - ※ 24時間バスのお風呂には使用しないでください。（浄化能力低下の原因）
- 水栓を閉めた後も、吐水口から少し水が出ることがありますが、異常ではありません。
- 水質切替ボタンの下に、点字表示をしています。（54ページ参照）

お 願 い

- **アルカリイオン水または浄水を通水したときブザーが「ピッピッ…」と鳴り、電極洗浄中ランプが点灯したら、吐水口から出ている水は使用しないでください。**（約15～50秒間）**自動洗浄をしています。**（35ページ参照）
- 気温が低く凍結のおそれがある場合は、カートリッジを取りはずしてください。

ブザーの音量は…

- 音声ガイドの設定音量（「3（大）」・「2（中）」・「1（小）」の3段階）と同じ大きさで鳴ります。（33ページ参照）

アルカリ・弱酸性・浄水を使う（つづき）

■ リモコン部の操作について

水切換レバーのリモコン部操作パネルで、水質の切り替えなどができます。

お願い

- 赤外線送信部に、ふきんなどをかぶせたり、手でおおったりしないでください。（誤動作の原因）
- 赤外線送信部が点灯しなくなったら、電池を交換してください。（14ページ参照）

お知らせ

- 同じキッチン内などで、リモコン方式のアルカリイオン整水器を2台お使いになる場合、それぞれのリモコンで操作するには、赤外線チャンネルの設定が必要です。
  下記の手順で、1台目を「ch1（チャンネル1）」に、2台目を「ch2（チャンネル2）」に設定してください。お買い上げ時は「ch1」に設定されています。

設定のしかた〔リモコンの動作確認後に、設定の操作をしてください。〕

①設定を変更する本体のみ電源プラグを差し込む
- もう1台の電源プラグは抜いておいてください。

②水栓を閉めた状態で、リモコン部操作パネルの つづける を本体のブザーが「ピー」と鳴るまで押す（約5秒間）
- 表示部に「ch2」が表示され（約3秒間）、本体とリモコン部の設定が、「ch2」に切り替わります。

※「ch1」に戻すときは…

もう一度 つづける を押す（約5秒間）
- ブザーが「ピッ…」と4回鳴り、表示部に「ch1」が表示されます。

■〔水栓絞る〕の表示が出たとき（アルカリ・弱酸性使用中のみ）

水の流量が多すぎる場合に表示します。
（十分なpHが得られないことがあります。）

▼

表示が消えるまで※
水栓をゆっくりと絞ってください。
※「アルカリ」の場合：流量約5.0 L/分
　「弱酸性」の場合：流量約3.2 L/分

お知らせ

- **〔水栓絞る〕の表示は、水質シグナル点灯後、3秒以内には出ません。**
- 〔水栓絞る〕の表示が出ている間は、現在の通水流量が表示されます。（点滅）
  流量調節の目安にしてください。
- 電解を強めに設定しているとき（30ページ参照）は、〔水栓絞る〕の表示が出やすくなります。
  （この場合、流量約2.5 L/分で消えます。）

■ 水質シグナルが消灯したとき

水栓を絞りすぎたり、水道水圧の変化で流量が低下すると、水質シグナルが消灯し表示部に「カートリッジ寿命」が表示されます。（アルカリ・弱酸性の場合は電解中止）
もし、水質シグナルが消灯したときは、再度水栓を開いて流量を調節してください。

お知らせ

- 弱酸性を使用していたときは、水質が「浄水」に切り替わります。
  再度［弱酸性］を押し、水栓を開いてください。

■ pHを知りたいときは

付属のpH試験液で測定してください。（22ページ参照）

「アルカリ優先」に設定する

弱酸性・浄水使用後に水栓を閉めたとき（水質シグナルが消灯したとき）、自動的に前回使用した「アルカリ」に戻る※ように設定できます。（通常は「浄水」）
※つづけるランプが点灯しているときは、ランプが消灯したあと戻ります。
操作は、水栓を閉めてから行ってください。（通水中は、操作できません。）

内　容	操作のしかた
「アルカリ優先」に設定する	［3 日常飲用］を「ピッ…」と4回鳴るまで押す（約3秒間）
設定を解除する	［3 日常飲用］を「ピー」と鳴るまで押す（約3秒間）

アルカリ・弱酸性・浄水を使う（つづき）

アルカリイオン水・弱酸性水の電解を強めにするときは

水質などの影響により、生成水のpHが「pHの目安」（24ページ参照）の範囲内に入らないときは、アルカリ・弱酸性の電解の強さを「強（強め）」に設定してください。pHが0.1～0.3程度変化します。（水質や使用条件により変化量に幅があります。）

- 一度設定した内容は、再度設定（変更）するまで記憶されます。

アルカリの設定を変更するとき

1 1 飲み始め 2 飲み慣れ 3 日常飲用 のいずれかを押す

2 電解強め を押す

- 1回押すごとに、下図のように設定が変わります。
- アルカリすべて（1 飲み始め 2 飲み慣れ 3 日常飲用）の、設定が変更されます。

弱酸性の設定を変更するとき

1 （ブザー切）弱酸性 洗顔 を押す

2 電解強め を押す

- 1回押すごとに、下図のように設定が変わります。
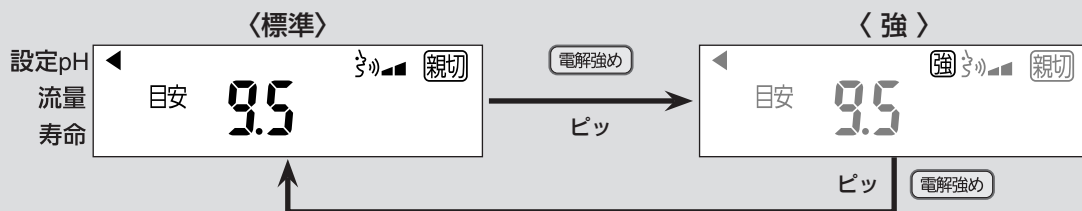
お知らせ

- 「強」の表示は、「強」に設定した水質を選択したときに出ます。浄水または「標準」に設定している水質に切り替えると消えます。
- 「強」に設定しているときは〔水栓絞る〕の表示が出やすくなります。（この場合、流量約2.5 L/分で消えます。）

原水(水道水)を使う

原水とは水道水そのままの水です。

水切換レバーを「ストレート」または「シャワー」に切り替えます。

水流が**ストレート**
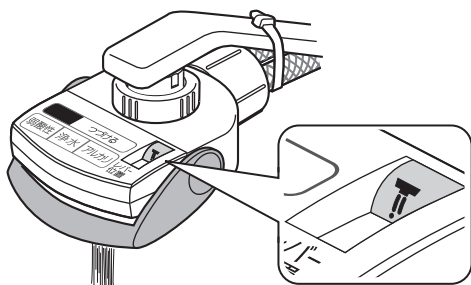
水流が**シャワー**
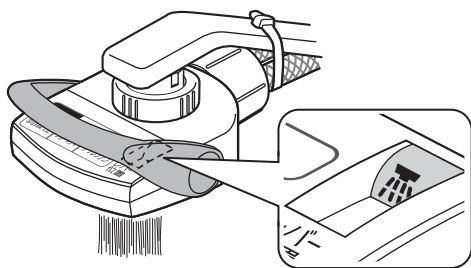
〔水切換レバーを下から見た図〕
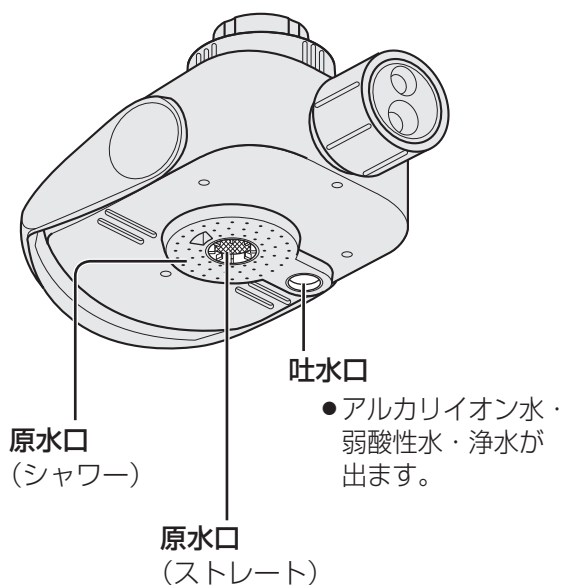
水切換レバーについて

使うことができる水温は右表の通りです。この温度で使用してください。

（故障またはカートリッジに吸着した総トリハロメタンの一部が放出される原因）

水切換レバーの位置	水　温
浄　　水	35 ℃未満
ストレート（原水）	80 ℃未満
シャワー　（原水）	

お知らせ

- 「ストレート」「シャワー」では、原水口から水道水そのままの水が出ます。
  アルカリイオン水・弱酸性水・浄水は、水切換レバーを「浄水」(26ページ参照)に切り替えて、吐水口から出る水をお使いください。

音声ガイドの設定を変える

音声ガイドには、「親切」・「通常（「親切」モード解除）」・「切」のモードがあり、お好みでモードの設定を変更できます。
お買い上げ時は「親切」モードに設定されています。

- 「親切」モードでは、通水し、飲用可または使用可になったときにも、音声ガイドで水質をお知らせします。（「通常」モードではブザーのみ）
- 「切」に設定すると、異常表示（43、44ページ参照）が出たときのみ、音声ガイドでお知らせします。

1 ブザーが「ピッ」と鳴るまで
［音声］設定(3秒押し) **を押す**（約3秒間）

- 1回押すごとに、下図のように設定が変わります。

お知らせ

- 音声ガイドを「切」に設定にしても、ブザーは鳴ります。
（音声ガイドを「切」にする前に設定していた音量になります。）

音量を変える

音声ガイドの音量は、「3（大）」·「2（中）」·「1（小）」の3段階に調節できます。
お買い上げ時は「2（中）」に設定されています。

1 音量 を押す

● 1回押すごとに、下図のように設定が変わります。
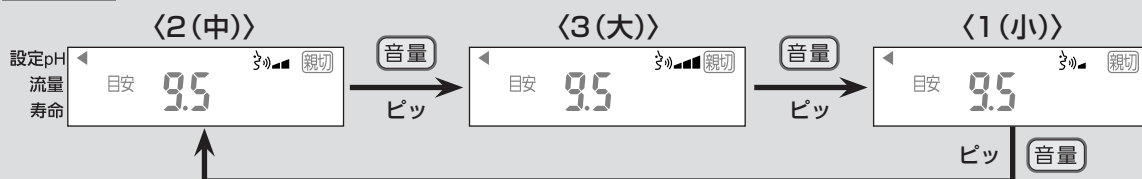
お知らせ

● 音声ガイドを「切」に設定しているときは、音量の設定は変更できません。
● ブザーの音量は、音声ガイドの設定と同じになります。

カルシウムを添加する（指定のpHが得られないとき）

pHを測定し（22ページ参照）、「pHの目安」の範囲内に入らない場合は、グリセロリン酸カルシウム製剤（カルシウム）を添加してください。範囲内に入っていれば、添加する必要はありません。
※ カルシウムの摂取を目的としたものではありません。

■ 添加のしかた（機器内部が不衛生にならないよう、清潔な手で添加してください。）

1 水栓を閉め、カバーを取りはずし、
カルシウム添加筒を取り出す（右図参照）

2 キャップをはずし、
添加筒とキャップの内側を水で洗う（水を振り切る）

- 水切換レバーを「ストレート」または「シャワー」に切り替えてから、洗ってください。
（「浄水」で通水すると、水があふれます。）
- 補充の際に、添加筒内やキャップの内側にカルシウムが残っている場合は、水をかけながら、はしなどを使ってきれいに取り除いてください。
（残っているものは、カルシウムが流出した後の残留物です。）
- 添加筒の網を破らないように注意してください。
- **キャップは、洗剤・アルコールなどで洗わないでください。（回りにくくなります。）**

3 カルシウム1袋（6 g）**を添加筒に入れる**

- **カルシウムを、本体に直接入れないでください。**
（故障の原因）

4 添加筒にキャップを取り付ける

5 添加筒を本体に取り付ける

- キャップは **閉** の位置まで確実に締めてください。
（キャップを取り付けずに通水すると、水があふれます。）

6 カバーを取り付ける（41ページ参照）
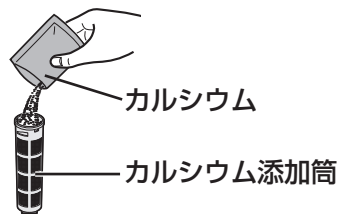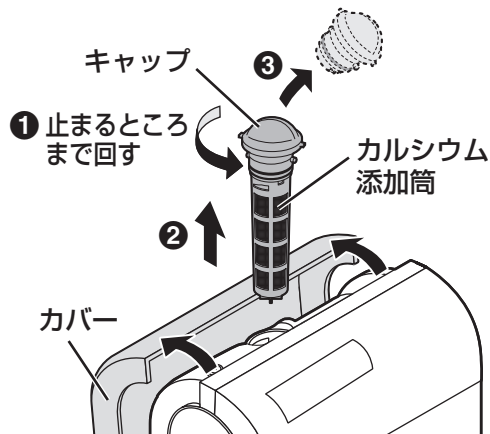
- 長期間（目安：約1週間以上）使用しないときは、残っているカルシウムはきれいに取り除いてください。

お知らせ

- **添加筒が不衛生になると、カビが発生することがあります。そのときは、別売品の「通水路洗浄剤」で洗浄してください。**（57ページ参照）
- カルシウムは、アルカリイオン水、弱酸性水、浄水のすべてに添加されます。

自動洗浄について

自動的に、吐水配管内のパイプクリーニングと、本体内の電極板に付着したカルシウム分の除去をします。

条件	操作	動作
アルカリイオン水を使用したあと	つづけるランプが消えているとき、水栓を閉めると	**約15秒間、電極自動洗浄をします。** 電極洗浄中ランプが約15秒間点灯 ●**排水ホースから出てくる水**(約90秒間)**は、使用しないでください。**
弱酸性水を使用したあと	水栓を閉めると	（同上）
24時間経過するごとに	アルカリイオン水または浄水を**通水すると**	**約10～15秒間、パイプクリーニング・電極自動洗浄をします。** ブザーが「ピッピッ…」と約3秒間鳴る
12時間以上使用しなかったとき	アルカリイオン水または浄水を**通水すると**	（同上）

●**パイプクリーニング・電極自動洗浄が終了するまで、止水しないでください。**
(途中で止水すると、同じ動作を繰り返します。)

●**吐水口や排水ホースから出てくる水は、使用しないでください。**(約15～50秒間)
ブザーが「ピッピッピッ」と3回鳴ってから使用してください。

お願い

●パイプクリーニング・電極自動洗浄中に、〔水栓絞る〕の表示が出た場合は、表示が消えるまで、水栓を絞ってください。
(流量約2.5 L/分で消えます。)

お知らせ

●電極洗浄中ランプは、パイプクリーニング・電極自動洗浄中であることをお知らせするものです。
●つづけるランプ点灯中は、電極自動洗浄をしません。

停電・断水したときには

■停 電 時

●使用中に停電したときは水栓を閉めてください。
●通水すると「浄水」が出てきます。
●通電後は通常通りに使用できます。
(通電後は「浄水」に自動的に戻ります。)
●停電しても、設定された内容は解除されません。
(通水中に設定している場合、解除されることがあります。)

■断 水 時

●使用できません。
●使用中に断水したときは水栓を閉めてください。
●断水が解除されたときは水切換レバーを「ストレート」または「シャワー」にして、まず原水(水道水)を流し、配管内の空気や濁った水を流し出してください。
その後は、通常通りに使用されても問題ありません。
(空気や濁った水を本体に通水すると、カートリッジの寿命が大幅に短くなるため)

お手入れ

本体・水切換レバー（リモコン部）

- 柔らかい布に水を含ませ、かたく絞ってふいてください。（特にリモコン送受信部）
- 原水口と吐水口の汚れ※は、歯ブラシなどで取り除いてください。

※洗い水の飛びはねが付着すると汚れや生活カビの原因になります。
また、吐水口から汚れや生活カビが吐水ホース内に入り、
汚れや水あかの原因になります。
使用するたびまたは定期的なお手入れをおすすめします。
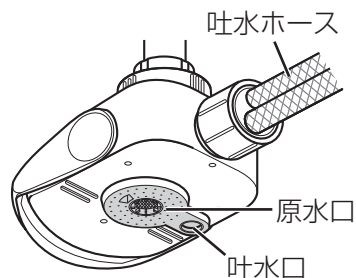
カルシウム添加筒・本体通水路

- 添加筒・吐水ホース内の汚れや水あか、においが気になる、またはカートリッジを交換しても、においやいやな味がとれない場合は、別売品の「通水路洗浄剤」で洗浄してください。
  1年に1回程度、洗浄されることをおすすめします。（57ページ参照）
  ※ カルシウム添加筒は、機器内部が不衛生にならないよう清潔な手で扱ってください。
- 水質の硬度が高い地域では、通水路にカルシウムが付着することがあります。
  1年に1回程度、別売品の「本体洗浄用カートリッジ」で洗浄してください。（57ページ参照）
  ※ クエン酸により、本体内に付着したカルシウムを除去します。
  （本体内をきれいにし、電解能力を保つ効果があります。）

水切換レバー取付口のフィルターに、ごみなどが詰まると水量が少なくなります。
1年に1回程度、下記の手順で清掃してください。

水切換レバー取付口（フィルター、注水口）

1 ナットをゆるめ、水切換レバーをはずし フィルターを取り出す

- 水切換レバーは「浄水」にしてください。
- 水切換レバー本体を少し回すと、ナットがゆるみやすくなります。
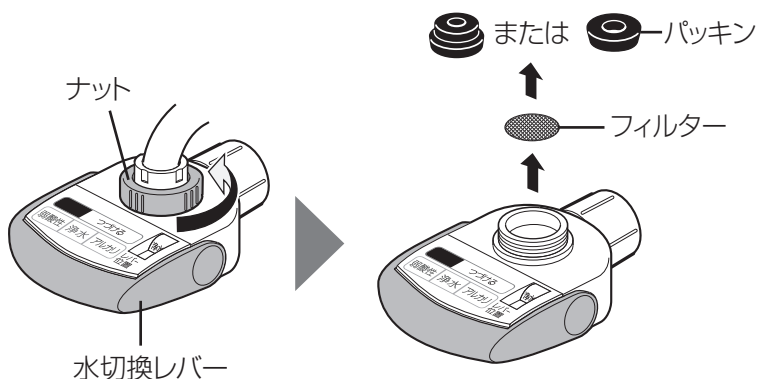
2 フィルターと注水口を洗う
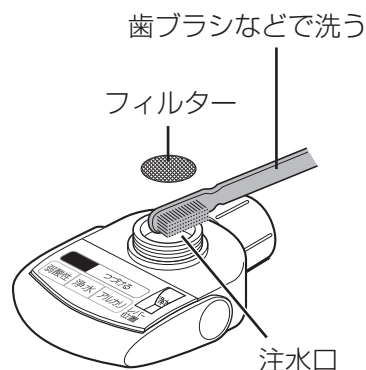
本体に水をかけたり、洗ったりしない

水ぬれ禁止

漏電・感電・故障の原因になることがあります。

お願い

- **洗剤・クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油などは使わないでください。まちがって使用したときは、すぐ水ぶきをし、表面の洗剤などを取り除いてください。**
（洗剤が通水に混じる、樹脂の割れ・塗装部のはがれ・変色・変形の原因）
- 金属製のブラシなどは使わないでください。（きずの原因）
- ナットを締めつけるときは、工具を使わないでください。（ナット破損の原因）
- リモコン部電池ケースのフタ部分に、水を直接かけたり、洗ったりしないでください。（故障の原因）
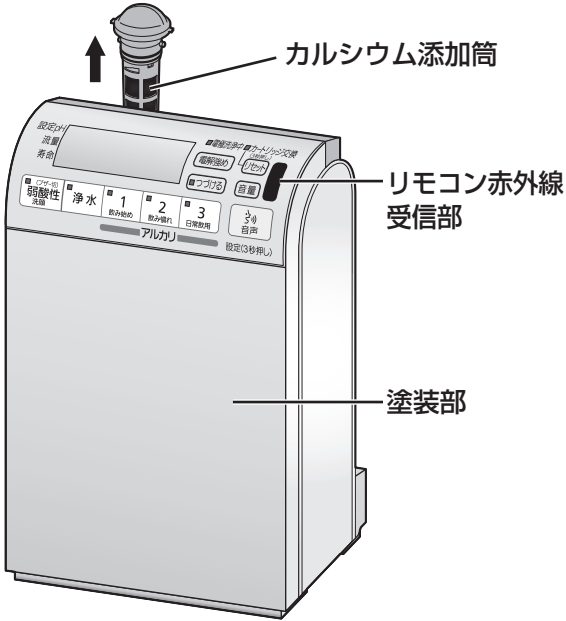
3 水切換レバーを取り付ける

- フィルターを必ず取り付けてください。
- **取り付け後、「ストレート」または「シャワー」で水を流してください。（約5秒間）**

カートリッジを交換する前に

交換表示について

通水量と通電時間を積算し、表示部にカートリッジ寿命を表示します。交換の目安にしてください。

- カートリッジ寿命(6 000リットル)は、標準的な水質・水圧による試験(家庭用浄水器試験方法：JIS S 3201)での数値であり、一般の水道水では水質(濁り、鉄サビなど)・水圧により、目詰まりの時期に大幅な差が出ることがあります。

カートリッジ寿命表示

- カートリッジの交換目安となる総通水量(6 000リットル)までの残量を、1リットル単位で表示します。
※ 数値は、通水するごとに減っていきます。

カートリッジの使用可能年月(2年)までの日数が、あと10日(240時間)になると…

残り時間を1時間単位で表示します。
※ 数値は、時間経過ごとに減っていきます。

(残り時間表示例：残り240時間)

設定pH 流量 寿命 ◀ 目安 あと 240h 親切

(例)

カートリッジ交換ランプ(赤色)

- カートリッジの目詰まりなどで流量が低下した場合や、カートリッジ寿命表示が、「150 L」以下または「240 h」以下になった場合に点滅します。

点 滅：(通水中のみ)	▶	**点 灯：**(常 時)
●交換時期が近づいています。 ※ 交換用カートリッジを準備してください。		●交換してください。 ※ 点灯中は、アルカリイオン水、弱酸性水は生成できません。

交換時期について

■ **カートリッジ交換ランプが点灯したら交換をしてください。**

カートリッジ交換ランプが点灯すると、表示部に下記のような表示が出ます。(43、44ページ参照)

表　示	処　置
設定pH 流量 ◀ 寿命 U25	**目詰まりによるカートリッジの寿命です。** ●43ページ「U25」の内容を確認の上、カートリッジの目詰まりであれば、カートリッジを交換してください。
設定pH 流量 寿命 ◀ U26	**総通水量が6 000リットルを超えました。** ●カートリッジを交換してください。
設定pH 流量 寿命 ◀ U30	**カートリッジの使用期間が2年を超えました。** ●カートリッジを交換してください。

交換時期について（つづき）

■ カートリッジ交換ランプが点灯しなくても、次のような場合は交換をしてください。

●においやいやな味がするとき（カートリッジの除去能力の低下）

■ カートリッジ交換の目安と除去できる物質

〔交換用カートリッジ　品番：TK7415C1〕

交換目安	1日 15リットル使用したとき　約1年
除去できる物質	遊離残留塩素・濁り・総トリハロメタン・クロロホルム・ブロモジクロロメタン・ジブロモクロロメタン・ブロモホルム・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)・溶解性鉛

■ 水質による使用期間の違いについて

カートリッジには、細かな汚れを除去するために、中空糸膜フィルターが内蔵されていますので、目詰まり物質が多い水質では使用期間が短くなります。

中空糸膜表面（新品時）

目詰まりした中空糸膜表面

① 目詰まり物質の多い水質

② 標準的な水質

お知らせ

●次の場合、吐水量が少なくなることがあります。

- 水温が低い場合（カートリッジに水が通りにくくなるため）
- 水圧が低い地域（70 kPa以下）で使用した場合
- 地域の水道使用状況により、水道水圧が低下した場合
- 水道工事の直後など、断水していた場合

カートリッジを交換する

- **交換用カートリッジの品番は、「TK7415C1」です。**
  （パナソニックの製品を扱っている販売店で購入してください。）
- **電源プラグは抜かずに、交換してください。**
  （電源プラグを抜くと、カートリッジ寿命のリセットができません。）
- **水栓を閉めてから交換してください。カートリッジをはずした状態で通水しないでください。**（水があふれ出るため）

1 カバーを取りはずし、カートリッジを取りはずす

- **カートリッジをはずすとき、またははずした状態で、本体を倒したり、逆さまにしたりしないでください。**
  （機器内部に水が入り、故障の原因）
- カートリッジから水が落ちますので、注意してください。この水が本体の底面から出てくることがあります。
  （水漏れではありません。）
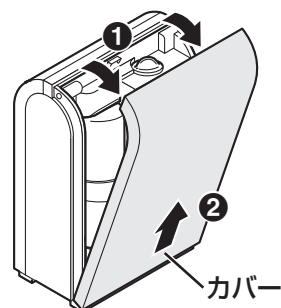
2 新しいカートリッジを取り付ける

- **取り付けたあと、カートリッジを押し上げてください。**
- **カートリッジの品番ラベル(銀色)は、はがさないでください。**
  （水が漏れる場合があります。）
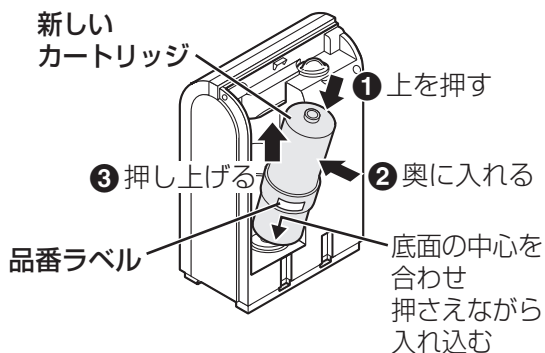
3 （3秒押し）リセット を押す（約3秒間）

●ブザーが「ピー」と鳴り、**カートリッジ交換ランプが消えるまで**押してください。
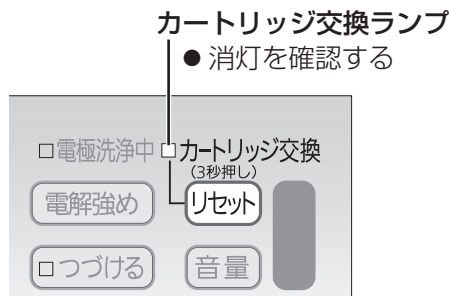
4 水栓を開き、本体に通水する（約3〜4分間）

●通水すると水質シグナルが約20〜30秒間点滅後、点灯に変わります。
●通水中、カートリッジ取付部から水漏れがないことと、排水ホースから水が出ていることを確認してください。
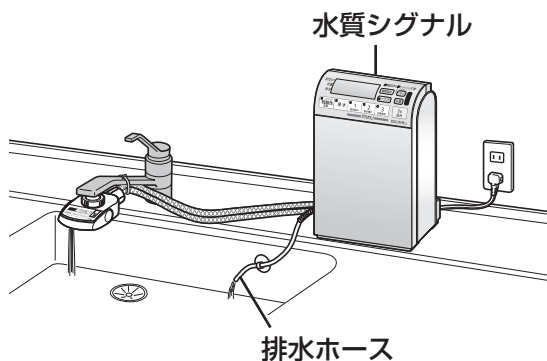
5 水栓を閉め、カバーを取り付ける
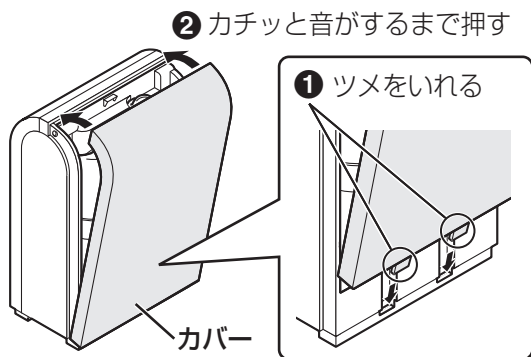
お願い

● **使用済みのカートリッジは、地域で定められた条例に従って廃棄してください。**
（カートリッジケースの材質はABS樹脂です。ろ材の種類は56ページ「仕様」を参照してください。）
● **カートリッジ交換ランプが点滅または点灯する前にカートリッジを交換する場合も、**必ず手順3で（3秒押し）リセット をブザーが「ピー」と鳴るまで押し続けてください。（約3秒間）
〔カートリッジ寿命を正しく表示するため〕

お知らせ

● カートリッジ交換後、アルカリイオン水をコップに注ぐと白い泡がつくことがありますが、異常ではありません。（55ページ参照）

本体を移設するときには

下記の手順で、本体の水抜きをしてください。

※ カルシウム添加筒は、機器内部が不衛生にならないよう清潔な手で扱ってください。

1 電源プラグを抜き、カバーを取りはずし カルシウム添加筒を取りはずす

- 添加筒内にカルシウムが残っている場合は、きれいに取り除いてください。
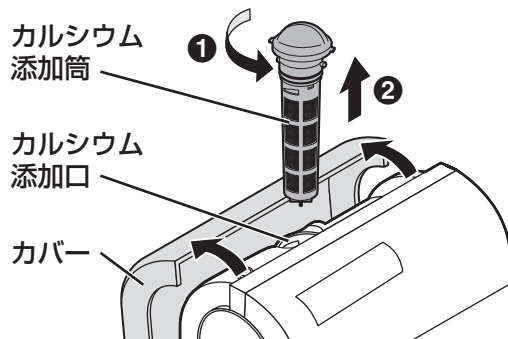
2 本体を逆さまにして、カルシウム添加口から 内部の水を排水する

3 水切換レバーから 給水・吐水ホースを取りはずす

- 給水・吐水ホースをはずした後、ホース締付ナットとホースガイドは、水切換レバーに元どおり取り付けてください。
（紛失を防止するため）
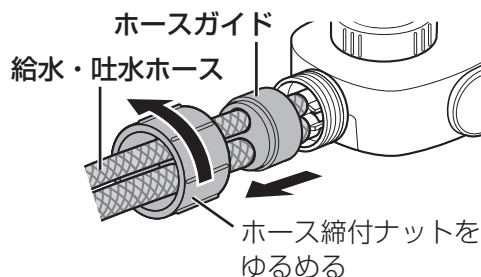
4 カートリッジを取りはずす

- **カートリッジをはずすとき、またははずした状態で、本体を倒したり、逆さまにしたりしないでください。**
（機器内部に水が入り、故障の原因）
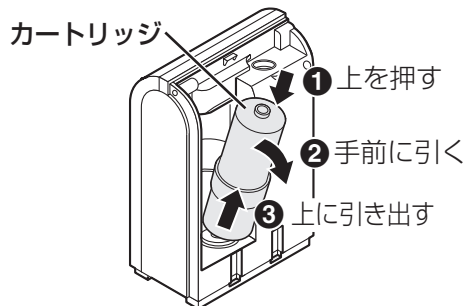
5 給水・吐水ホース先端を 本体より低い位置に置いて ホース内の水を排水する

- 吸盤を取りはずしてください。
- **取りはずした添加筒・カートリッジ・カバーは、もとに戻してください。**
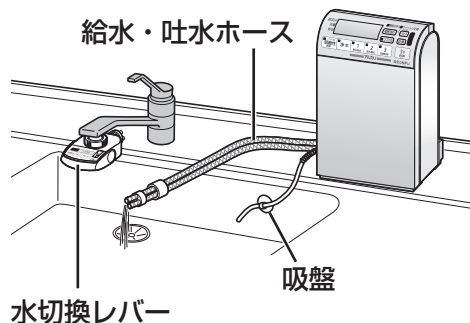
6 水切換レバーを取りはずす

- 水切換レバー内の水は、出してください。
- **ナットを固く締めつけた後、水切換レバーごと回転させると、はずれやすくなります。**
※ はずれないときは、プライヤーなどの工具を使用してください。

- この方法でも十分に水抜きされていないことがありますので、輸送時には水漏れを考慮して包装してください。

このような表示が出たときには

液晶表示に下記のような表示が出たときは、各々の処置をしてください。処置をしても表示が出る場合は、電源プラグを抜いて販売店にご相談ください。
ただし、H31～H34（44ページ参照）の表示が出たときは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店に連絡してください。

異常表示	原因と対応いただく内容
U21・U27	●アルカリイオン水または弱酸性水を、連続して30分以上使用すると「U27」が表示されます。 ●水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止します。（吐水口からは浄水が出ています。） ➡水栓を閉め、約3分間待って再度使用してください。 音声「保護回路がはたらきました 水栓を閉めて約3分間お待ちください」
U23	●水質、環境によっては、機器の保護のため電気分解を中止します。（吐水口からは浄水が出ています。） ➡水栓を閉めて使用を中止し、約30分間お待ちください。（水質、使用環境によっては、30分以上かかることがあります。） 音声「保護回路がはたらきました 水栓を閉めて約30分間お待ちください」
U25	**流量が1.2 L/分を超えません。（通水すると、表示部に現在の流量が表示されます。）** **※ 電源プラグを一度抜き、再度差し込んでください。** ●水栓を絞りすぎていませんか？ ➡水栓を開けてください。 ●水圧が低すぎませんか？ ➡水栓を全開にしてください。 ●給水・吐水ホースが折れていませんか？ ➡ホースをまっすぐにしてください。 ●水切換レバーのフィルターが目詰まりしていませんか？ ➡フィルターを清掃してください。（36～37ページ参照） **※以上の処置を行っても、再度「U25」が表示される（流量が1.2 L/分を超えない）場合は** ●目詰まりによるカートリッジの寿命です。 ➡カートリッジを交換してください。（40～41ページ参照） 音声「カートリッジの目詰まり寿命です… カートリッジの品番や交換のしかたは…」
U26	**交換の目安となる総通水量（6 000リットル）を超えました。** ●カートリッジの寿命です。 ➡カートリッジを交換してください。（40～41ページ参照） 音声「カートリッジの寿命です… カートリッジの品番や交換のしかたは…」

次ページにつづく

異常表示	原因と対応いただく内容
U28	●電解槽の寿命予告です。 （電解時間の累積が約847時間になると予告をします。） ➡**販売店にご相談ください。** 電解槽寿命は約850時間です。 止水して、電源プラグを一度抜き、再度差し込むと、寿命までの残り約3時間（1日10分使用して、約3週間）使用できます。 音声「電解槽の寿命が近づいています 水栓を閉めて電源プラグを抜き差ししてください」
U30	**カートリッジの使用期間が2年を超えました。** ●カートリッジの寿命です。 ➡カートリッジを交換してください。（40～41ページ参照） 音声「カートリッジの寿命です… カートリッジの品番や交換のしかたは…」
H31	●電解槽の寿命です。 電解時間：累積約850時間（イオン水生成時間・洗浄時間のみ） ➡**販売店に電解槽の交換を依頼してください。** 音声「電解槽の寿命です 電源プラグを抜いて販売店に相談してください」
H32~H34	●機器の故障です。 ➡**電源プラグを抜き、表示内容を販売店にご連絡ください。** 音声「異常が発生しました 電源プラグを抜いて販売店に相談してください」

お知らせ

●表示は、下記の種類で区別しています。

U00 ········ お客様で対応できます。

H00 ········ **販売店にご相談ください。**

修理を依頼されるときは、この異常表示をお知らせください。

●異常表示が出たときの音声ガイドの音量は、設定にかかわらず（「切」に設定している場合も）、「3（大）」になります。

●音声ガイドをもう一度聞くときは、［音声］を押してください。

故障かな？と思ったときには

万一故障かなと思われることがありましたら、修理依頼される前に次のことを調べてください。
なお、異常のときは、ご自分で分解修理は絶対しないで、お買い上げの販売店に連絡してください。
※ 一度電源プラグを抜き、再度差し込むと、正常に復帰する場合があります。

	症　状	原因と対応いただく内容	参照ページ
表示部（液晶表示）	何も表示（点灯）しない	●電源プラグが抜けていませんか？ ➡電源プラグを差し込んでください。	—
	液晶表示が突然消えた	●節電のため、使用していないときは、自動的に表示が消えるようになっています。 ➡故障ではありません。	25
	使用中に水栓を絞ると、突然「カートリッジ寿命」が表示される	●水栓を絞りすぎたり、水圧の変化で流量が低下したためです。（水質シグナル消灯） ➡「弱酸性」をご使用の場合は、再度水質切替ボタンを押し、水栓を開いて流量を調節してください。	29
	下記のような表示が出た 〔表示部〕（例） 目安 あと 240h 親切	●カートリッジの使用可能年月（2年）までの日数が、あと10日（240時間）になりました。 ➡故障ではありません。 残り時間を、1時間単位で表示しています。	38
リモコン	リモコンによる操作ができない	●直射日光や蛍光灯の光が、本体のリモコン赤外線受信部に直接あたっているのでは？ ➡本体の向きを変え、リモコン赤外線受信部に光が直接あたらないようにしてください。	—
		●リモコン部操作パネルのボタンを押したとき、赤外線送信部が点灯（赤色）していないのでは？ ➡電池の寿命です。電池を交換してください。	14 15
		●本体とリモコン部の赤外線チャンネルが合っていないのでは？ ➡赤外線チャンネルの設定をしてください。	28
水質シグナル	点灯しない、または使用中に消灯する	●設置直後またはカートリッジ交換直後は、通水すると約20〜30秒間点滅後に点灯します。 ➡約3〜4分間通水してください。 （カートリッジ内の空気を抜くため）	8 41
		●流量が不足していませんか？（約1.2 L/分 以上必要） ➡水栓を開け、流量を多くしてください。	—
		●**カートリッジ交換ランプが点灯していませんか？** ➡カートリッジを交換してください。	40 41

次ページにつづく

故障かな？と思ったときには（つづき）

	症　状	原因と対応いただく内容	参照ページ
水質シグナル	アルカリイオン水または浄水を通水すると、ピンクに点滅する	●24時間経過するごとに、または12時間以上使用しなかった場合は、自動的にパイプクリーニング・電極自動洗浄をします。（ブザーが「ピッピッ…」と鳴り、電極洗浄中ランプが点灯） ➡約15～50秒間通水してください。	35
水質表示ランプ	「弱酸性」使用後、ランプが「浄水」に変わる	●「弱酸性」使用後、水栓を閉めると自動的に「浄水」に切り替わるようになっています。 ➡故障ではありません。	27
	「弱酸性」「浄水」使用後、ランプが「アルカリ」に変わる	●「アルカリ優先」に設定されているのでは？ ➡アルカリ優先を解除する場合は、本体に通水していないときに、[3 日常飲用] をブザーが「ピー」と鳴るまで押してください。（約3秒間）	29
カートリッジ交換ランプ	カートリッジを交換しても、ランプが消えない	●リセットボタンを押し忘れていませんか？ ➡ブザーが「ピー」と鳴るまで、リセットボタンを押してください。（約3秒間） ●電源プラグを抜いた状態で、リセットボタンを押したのでは？ ➡電源プラグを差し込み、ブザーが「ピー」と鳴るまで、リセットボタンを押してください。（約3秒間）	40 41
	カートリッジ寿命表示が「150 L」以下または「240 h」以下になっていないのに、ランプが点滅する ※ 吐水量が少ない、または出ない	**※電源プラグを一度抜き、再度差し込んでください。** ●水栓をしぼりすぎていませんか？ ➡水栓を開けてください。 ●水圧が低すぎませんか？ ➡水栓を全開にしてください。	—
		●給水・吐水ホースが折れたり、つぶれたりしていませんか？ ➡まっすぐにしてください。	17 18 19
		●水切換レバーのフィルターが目詰まりしていませんか？ ➡フィルターを清掃してください。	36 37
		●カートリッジを確実に取り付けていますか？ ➡確実に取り付けてください。	40 41
		●断水していませんか？ ➡水が出るまでお待ちください。	35
		●カートリッジの目詰まりなどで流量が低下しています。 ➡故障ではありません。 カートリッジの交換時期が近づいています。	38 39

	症　状	原因と対応いただく内容	参照ページ
カートリッジ交換ランプ	カートリッジの使用期間が2年をすぎても、ランプが点灯しない	●電源プラグを、長期間抜いていたのでは？ ➡故障ではありません。 電源プラグを抜いていると、通水量および通電時間が積算されないため、カートリッジ寿命が正しく表示されません。 ※カートリッジの使用期間が2年をすぎている場合は、交換してください。	38 39
水切換レバー	選択した吐水口以外から水漏れする	●水切換レバー内部へのカルシウムなどの付着が原因と考えられます。 ➡薬店でクエン酸をお求めいただき、1リットルの水に約50 gの割合で溶かしてください。リモコン部を取りはずして、水切換レバーを約12時間つけた後、水洗いしてください。	—
排水ホース	使用後、水栓を閉めた後に水が出る	●電極自動洗浄または本体の水抜きをしています。 ➡故障ではありません。	27 35
	使用中、水が出ない	●排水ホースが折れたり、つぶれたりしていませんか。 ➡まっすぐにしてください。	17 18 19
	使用中、出ている水がとぎれる	●吐水口と排水ホース先端の、高低差が小さいのでは？ ➡高低差を大きくしてください。	18
その他	においやいやな味、濁りがとれない	●カートリッジの除去能力が低下しています。 ➡カートリッジを交換してください。	40 41
		●カートリッジ交換後、2～3ヵ月以内に、においがした場合は、通水路またはカルシウム添加筒に汚れが付着している可能性があります。 ➡別売品の「通水路洗浄剤」で洗浄してください。	57
		下記の場合、ホース内に水が残り、においの原因になります。 ●ホースを束ねているのでは？ ➡ホースは束ねないでください。 長すぎる場合は、切って使用してください。 ●ホースが浮いているのでは？ ➡浮かないように固定してください。 ●給水・吐水ホースが、キッチンカウンターより低くなっているのでは？ ➡キッチンカウンターより低いところを通らないようにしてください。	18

次ページにつづく

故障かな？と思ったときには（つづき）

	症　状	原因と対応いただく内容	参照ページ
その他	通水しても音声ガイドが鳴らない	●音声ガイドのモードを、「通常」または「切」に設定しているのでは？ ➡「親切」モードに設定してください。	32
	本体に通水すると水が温かい	●通水初期は、止水中に室温や本体内の熱により温められた水が出ることがあります。 ➡故障ではありません。水を流してください。	—
	「弱酸性」を使用してもブザーが鳴らない	●ブザーが鳴らないように設定されているのでは？ ➡本体に通水していないときに、［弱酸性］をブザーが「ピッ…」と4回鳴るまで押してください。（約3秒間）	27
	生成水のpHが「pHの目安」の範囲に入らない	●カートリッジが新しいとき（約1週間）は、pH がやや高くなることがあります。 ➡故障ではありません。 約1週間後、再度 pHを測定してください。	—
	弱酸性水の pHが中性を示す	●弱酸性水の pHが6.5程度の場合は、pH測定表の pH 7（中性）と見分けがつかないことがあります。 ➡「弱酸性」を使用中に排水ホースから出てくる水を測定し、pHが10～11を示していれば、弱酸性水は pH6.5 程度になっています。	—
	本体の下から水が出る	●温湿度条件によっては、本体内部に結露水が発生することがあります。 ➡故障ではありません。 別売品の「結露水排水ホース」を取り付けてください。（本体底面イラスト参照）	17 58
	使用後、水栓を閉めた後に本体から音がする	●本体内の水を排水している音です。 ➡故障ではありません。	—
	アルカリイオン水のpHがアルカリ性を示さない	●水質切替ボタンが「アルカリ」になっていないのでは？（「弱酸性」または「浄水」になっている） ➡水質切替ボタンを「アルカリ」に切り替えてください。	26
		●原水の水質によっては、アルカリ性を示さない場合があります。（水中の炭酸の影響） ➡故障ではありません。アルカリの電解の強さを「強（強め）」に設定してお使いください。	30 54
		●排水ホースが折れたり、つぶれたりしていませんか？ ➡正しく電気分解できません。まっすぐにしてください。	17 18 19
	pHが上がりにくくなってきた	●本体内にカルシウム分が付着し、電解能力が低下しています。 ➡別売品の「本体洗浄用カートリッジ」で洗浄してください。	57

症　状		原因と対応いただく内容	参照ページ
その他	弱酸性水がにおう（プールのようなにおい）	●電気分解により水中の塩素イオンが弱酸性水に集まり、次亜塩素酸が発生するためです。 ➡故障ではありません。	53
	カルシウム添加筒が変色する	●カルシウム添加筒に汚れが付着しています。 ➡別売品の「通水路洗浄剤」で洗浄してください。	57
	アルカリイオン水に白い浮遊物が混じる	●本体内部に付着したカルシウム分です。 ➡別売品の「本体洗浄用カートリッジ」で洗浄してください。	57
	カートリッジ交換後の、吐水量が少ない	●カートリッジ内の空気が抜けていないためです。 ➡故障ではありません。約3～4分間通水してください。	―
	水を止めても、吐水口からポタポタと水が出る	●ホース内の水が抜けています。 ➡故障ではありません。	27

故障かな？と思ったときには（つづき）

■ 水漏れがあるときには

水漏れ個所	原因と対応いただく内容	参照ページ
水切換レバー接続部	● 水切換レバーを水栓に確実に取り付けていますか？ ➡ 確実に取り付けてください。 ※泡沫用つぎての締めつけが弱いときは、給水・吐水ホースをいったん取りはずし、水切換レバーごと回転させると、しっかり締めつけられます。	12 13
	● 水切換レバー内の部品は正しく入っていますか？ ➡ 正しく取り付けてください。	37
給水・吐水ホース接続部	● 給水・吐水ホースを水切換レバーに確実に取り付けていますか？ ➡ 奥まで差し込み、ホース締付ナットで締めつけてください。	18
本体上部	● カルシウムキャップを本体に確実に取り付けていますか？ ➡ カルシウムキャップは「閉」の位置まで締めてください。	34
本体底部	● カートリッジを確実に取り付けていますか？ ➡ 確実に取り付けてください。	40 41
水栓部分	● 水栓のパッキンが古くなっていませんか？ ➡ 水道工事店にご相談ください。 ● 水栓（断熱キャップなど）にひび割れがありませんか？ ➡ 水道工事店にご相談ください。	—

Q&A（ご質問にお答えします。）

よくあるご質問

Q カートリッジを交換したいのですが、どのカートリッジが使用できるのですか？

A **カートリッジ品番TK7415C1をご使用ください。**

Q 本体にお湯を通したのですが、大丈夫でしょうか？

A **多少であれば問題ありません。本体に30秒程度水を通し、本体内部の温度を下げてください。**

Q アルカリイオン水は、どのくらい日持ちするのですか？

A **常温では24時間以内にお使いください。**

アルカリイオン水の場合、水道水の中の塩素（殺菌剤）が除去されており、一般細菌が増えやすくなっています。
冷蔵庫で保存する場合でも、清潔な密閉容器に入れて2日以内にお使いください。
※弱酸性水の場合も2日以内にお使いください。

Q アルカリイオン水は、氷にしても使えるのですか？

A **使えます。**

氷にした場合、水道水で作った氷と同じようにお使いください。
自動製氷機能付きの冷蔵庫でタンクにくみ置きする場合は、2日以内で交換してください。

Q 薬を服用しているのですが、アルカリイオン水を飲んでも大丈夫でしょうか？

A **薬を服用する場合は、「浄水」をお使いください。**

薬服用以外の飲用、調理にはアルカリイオン水をご使用いただけます。

Q グリセロリン酸カルシウム製剤とはどういうものですか？

A **グリセロリン酸カルシウム製剤は、食品添加物として認められているもので、飲んでも問題ありません。**

Q グリセロリン酸カルシウム製剤は、必ず添加しないといけないのでしょうか？

A **pHを測定してください。（22ページ参照）pHが「pHの目安」の範囲内に入っていれば、添加する必要はありません。**

範囲内に入らない場合は、グリセロリン酸カルシウム製剤を添加してください。pHが0.1～0.3程度上がります。なお、これはカルシウムの摂取を目的としたものではありません。

Q 初めてアルカリイオン水を使うのですが、どうしたらいいでしょうか？

A **初めて飲む方は、「アルカリ1（飲み始め）」からご使用ください。**

少量（コップ1～2杯）ずつを2週間程度使用し、アルカリイオン水に慣れてから、「アルカリ2（飲み慣れ）」または「アルカリ3（日常飲用）」でご使用ください。初めから「アルカリ3（日常飲用）」で飲むと、体調を損なうことがあります。

次ページにつづく

Q&A（ご質問にお答えします。）（つづき）

Q 地下水は使用できないのですか？

A 使用できない場合があります。

地域・水質によっては、指定の pHが得られないことがあります。特に地下水を水源とした地域では、設置前にpHが得られるかを確認するため、酸度測定試薬による酸度の測定を販売店にご相談ください。

Q 腎臓に持病があるのですが、アルカリイオン水を飲んでも大丈夫でしょうか？

A アルカリイオン水を飲用する前に医師にご相談ください。

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。

- カルシウム・マグネシウム・ナトリウム・カリウムなどのミネラル分が、水道水より増えていること
- pH 9.5 程度のアルカリ性であること

Q 長期間(目安：約1週間以上)使用しないときは、どうするのですか？

A
- **カルシウム添加筒に残っているカルシウムを取り除いてください。**
- **カートリッジは本体から取りはずしてビニール袋に入れ、空気を抜いて口を閉じてから冷蔵庫に保管してください。**
- **電源プラグを抜いてください。**
- **再使用するときは、カートリッジを取り付けた後、電源プラグを差し込み、約3分間通水し水漏れがないか、また動作や表示に異常がないかを確認してください。**

1ヵ月以上使用しない場合は、カートリッジ内の水が変質することがありますので、カートリッジの交換をおすすめします。
また、においやいやな味がするときは、別売品の「通水路洗浄剤」(57ページ参照)で洗浄してください。

Q 電解槽寿命850時間とは？

A 電解槽で電気分解ができる累計時間を表し、1日20分使用した場合、約7年相当になります。

電解槽に通電することで電極板が消耗します。「H31」の表示が出たら電解槽の寿命です。販売店に電解槽の交換を依頼してください。

Q 乳幼児にはどのような水を飲ませたらいいのですか？

A 乳幼児には「浄水」の飲用をおすすめします。

乳幼児は、成人にくらべ胃腸の発達が未熟なため、離乳食に合わせて、「アルカリ1（飲み始め)」から徐々にならしてください。

Q 間違えて酸性水を飲んでしまったのですが、大丈夫でしょうか？

A 少量(コップ1杯程度)なら、心配ありません。

ただし、継続的な飲用はしないでください。また、誤って多量に飲んで体調が悪くなったときは、医師にご相談ください。

Q 吐水口と排水ホースからは、全流量に対して、それぞれどれくらいの割合で水が出ているのですか？

A 下記の割合になりますが、量りかたに注意してください。

吐水口から出る水　　：約80 %
排水ホースから出る水：約20 %

水が各々出ている状態で同じ容器に同じ時間だけ受けて比べてください。

- 出始めは排水ホースからの水が若干多くなります。
- 止水後は、本体内の水が抜けるため、排水ホース側に多めの水がたまります。
- 流量が少ない場合、排水ホースからの水が若干多くなります。

Q カルシウムの補充周期は？

※pHが「pHの目安」の範囲内に入っていれば、カルシウムを添加する必要はありません。

A 水質・水温・使用条件などによって異なりますが、目安として約14日間（1日15リットル使用した場合）**です。**

連続通水した場合などは、カルシウムの溶けかたが早くなることがあります。また、使用水量が少なく、カルシウムが残っている場合は、1ヵ月以内に取り除き、よく洗ってから新しいカルシウムを入れてください。

パナソニックのホームページ http://panasonic.jp/ の「アルカリイオン整水器」でも、ご覧いただけます。

Q やかんやジャーポットなどの容器に白い粉がつきますが何ですか？

A 水中のカルシウムが出てきたものです。

飲んでも問題ありませんが、気になる場合は容器を洗ってください。洗っても容器の白い粉がとれない場合は、薬店でクエン酸をお求めいただき、1リットルの水に50 gの割合で溶かし、2～3日つけた後洗い流してください。

Q 交換目安より早くカートリッジ交換ランプが点灯しましたが、どうしてでしょうか？

A カートリッジ交換ランプは通水量や通水圧力が低下した場合にも点灯します。
（38、39ページ参照）

水圧低下による通水量不足や、ホースに折れやつぶれがないか確認してください。また、水質によっては早期に目詰まりすることがありますので、その時はカートリッジを交換してください。

Q 使用しないときも電源は入れておくのですか？

A 使用しないときでも電源は入れたままにしてください。

自動洗浄をするためです。
また、電源を入れていないと、通水量および通電時間が積算されないため、カートリッジ寿命が正しく表示されません。
※ 待機時の消費電力は約0.4 Wです。

Q 電気代はどれくらいかかるのですか？

A 1ヵ月あたり、約14円です。

※1日10分使用、新電力料金目安単価 22円/kWh（税込）で算出

Q 鉛（溶解性鉛）は除去できないのですか？

A 除去できます。

Q 使い始めにくらべてpHが上がりにくくなったのですが、どうしてでしょうか？

A 本体内にカルシウム分が付着し、電解能力が低下したためです。

別売品の「本体洗浄用カートリッジ」（57ページ参照）での洗浄をおすすめします。

Q 使い始めにくらべてカルシウムが溶けにくくなったのですが、どうしてでしょうか？

A 原因として、カルシウム付着による通水路の詰まりが考えられます。

別売品の「本体洗浄用カートリッジ」（57ページ参照）での洗浄をおすすめします。

Q 総トリハロメタンとは、どういうものですか？

A クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムの4種類の化合物の総称です。

Q 2－MIBとは、どういうものですか？

A 2－メチルイソボルネオールの略称で、水道水のカビ臭原因物質のひとつです。

Q CATとは、どういうものですか？

A 2-クロロ-4, 6-ビス（エチルアミノ）-S-トリアジンの別名で、農薬の一種です。

Q 弱酸性水がにおうのですが、どうしてでしょうか？（プールのようなにおい）

A 弱酸性水に次亜塩素酸が多く含まれているためです。
そのままお使いいただいて問題ありません。

電気分解により水中の塩素イオンが弱酸性水に集まり次亜塩素酸が発生します。

Q アルカリイオン整水器の近くにラジオを置くと雑音が入る？

A 本器の近くではラジオに雑音が入ることがあります。
ラジオを本器から離してください。

次ページにつづく

Q&A（ご質問にお答えします。）（つづき）

Q 使用原水（水道水）の性質別の使用上のポイントは？

A 下表を参考にしてください。

ただし、炭酸を多く含んだ水では、生成したアルカリイオン水が炭酸の影響を受け、アルカリ性を示さない場合があります。この場合アルカリイオン水を沸騰させると炭酸が抜け、本来のアルカリ性を示します。
また※硬度の高い水の場合は白く濁ることがあります。

- 特に地下水や地下水を含んだ水源ではアルカリ性になりにくいため、アルカリの電解の強さを「強（強め）」に設定してお使いください。

	海辺や島	温泉地	炭酸を多く含んだ水（地下水）	硬度の高い水	硬度の低い水
原水の性質	塩水が混入している場合がある	イオウ分が含まれており、酸性傾向	炭酸ガスが混入しており、酸性傾向 ミネラル分が多く電気が流れやすい	ミネラル分が多く電気が流れやすい	ミネラル分が少なく電気が流れにくい
電気分解されたアルカリイオン水の性質は？	アルカリ性になりやすい	硫酸イオンの働きでアルカリイオン水が中性傾向に	炭酸ガスによってアルカリイオン水が中性傾向に	アルカリ性になりやすい	アルカリ性になりにくい
アルカリイオン水ご使用上のポイント	弱めのアルカリを使う	強めのアルカリを使う 水栓を絞り、通水量を少なめにする	強めのアルカリを使う 水栓を絞り、通水量を少なめにする	弱めのアルカリを使う	強めのアルカリを使う 水栓を絞り、通水量を少なめにする

※ **硬度**：水に含まれるカルシウムやマグネシウムの濃度で、この濃度により、硬度の高い水・低い水になります。

Q 操作パネル上の、点字表示の内容は？

A 下表のとおりです。

ボタン	□（ブザー切）弱酸性 洗顔	□ 浄水	□ 1 飲み始め	□ 2 飲み慣れ	□ 3 日常飲用	音声
表示内容	さ	じょ	1	2	3	こえ
	酸性（さんせい）の「さ」	浄水（じょうすい）の「じょ」	アルカリの強さを「1～3」の数字で表示しています。 ●1→ 2 → 3 の順にアルカリが強くなります。			―――
お知らせ	飲用ではありません。	飲用です。				―――

パナソニックのホームページ http://panasonic.jp/ の「アルカリイオン整水器」でも、ご覧いただけます。

Q アルカリイオン水・弱酸性水使用中に排水ホースから水が出ないのは？

A 排水ホースが折れているか、つぶれています。

排水ホースから水が出ない状態で使用すると、故障の原因になります。また、正しく電気分解できませんので、排水ホースを点検し、水が出る状態に設置しなおしてください。

Q アルカリイオン水を飲みはじめたら下痢や発疹になった？

A 飲用を中止し医師にご相談ください。

ご相談の際は、下記2点をお伝えください。
- カルシウム・マグネシウム・ナトリウム・カリウムなどのミネラル分が、水道水より増えていること
- pH 8～9(飲み始め)程度のアルカリ性であること

Q アルカリイオン水には、カルシウムがどれくらい入っているのですか？

A 水中のカルシウムイオンは原水にくらべて電気分解により20%～30%増加します。また、グリセロリン酸カルシウムを添加した場合、水が電気分解されやすくなり、さらに約10%カルシウムイオンが増加します。

Q アルカリイオン水は、そのまま飲用する以外には使えないのですか？

A お料理やご飯の炊き水に、お茶やコーヒーにと、一般の水と同じようにお使いいただけます。(24ページ参照)

Q アルカリイオン水をコップに注ぐと白い泡がつきました。これは何ですか？

A 本体内の空気が混入したものか、または電気分解のときに発生した泡(水素ガス)です。設置後やカートリッジ交換後に多く発生することがあります。
そのままお使いいただいて問題ありません。

※弱酸性水の場合、発生する泡は酸素ガスです。

Q アルカリイオン水が光って見えますが何ですか？

※浄水の場合も同じ現象が現れることがあります。

A 水に溶けている成分（主としてミネラル分）が析出したものです。

飲んでも問題はありませんが気になる場合は、pH(水素イオン濃度)を低くしてお使いください。またカートリッジの機能が低下した場合も同様の現象が現れますので、その場合は新しいカートリッジと交換してください。

Q アルカリイオン水で作った氷の溶けた水に白いものが浮きますが何ですか？

A 水に含まれているミネラル分です。

水を凍らせたときに、ミネラル分が氷の表面に固まったもので、飲んでも問題ありません。

Q アルカリイオン水で炊飯すると、ごはんがべたつきますが、どうしたらいいですか？

A 水加減や、お米、炊飯器の種類によっては、べたついたり黄色になることがあります。アルカリイオン水のpH(水素イオン濃度)を低くするか、「浄水」をお使いください。

仕様

類別		機械器具(83)医療用物質生成器
一般的名称		連続式電解水生成器（JMDNコード 71024000）
医療機器分類		管理医療機器
販売名称		アルカリイオン整水器　TK8032
医療機器認証番号		223AKBZX00198000
定格		交流100 V　1.3 A　50 ― 60 Hz
消費電力		約70 W（待機時：約0.4 W）
本体	寸法	幅165 mm×奥行95 mm×高さ269 mm
	質量	約2.1 kg（満水時：約2.6 kg）
本体使用水温		35℃未満（水切換レバーは80 ℃未満）
本体使用可能水圧（動水圧）		70 kPa～350 kPa
使用可能配水管圧力（静水圧）		70 kPa～750 kPa
電解	電解方式	連続電解方式
	吐水量（生成水流量）	1.9 L/分［水圧100 kPaのとき］
	電解能力切替	アルカリ：3段階　弱酸性：1段階
	連続使用可能時間	常温時約30分間　（注2）
	電解槽寿命	累積約850時間（イオン水生成時間・洗浄時間のみ）
	電極洗浄	オートクリーニング方式
浄水吐水量		1.9 L/分［水圧100 kPaのとき］
ろ過流量		2.4 L/分［水圧100 kPaのとき］　（注1）
本体装着カートリッジ		TK7415C1
浄水能力（注1）	遊離残留塩素	6 000 L　（注3）
	濁り	6 000 L　（注4）
	総トリハロメタン	6 000 L　（注3）
	クロロホルム	6 000 L　（注3）
	ブロモジクロロメタン	6 000 L　（注3）
	ジブロモクロロメタン	6 000 L　（注3）
	ブロモホルム	6 000 L　（注3）
	テトラクロロエチレン	6 000 L　（注3）
	トリクロロエチレン	6 000 L　（注3）
	1,1,1-トリクロロエタン	6 000 L　（注3）
	CAT（農薬）	6 000 L　（注3）
	2－MIB（カビ臭）	6 000 L　（注3）
	溶解性鉛	6 000 L　（注3）
ろ材(カートリッジ)の取替(交換)時期の目安		約1年　（注5）
ろ材の種類		不織布・粒状活性炭・セラミック・粉末活性炭・中空糸膜
除去できる物質		遊離残留塩素・濁り・総トリハロメタン・クロロホルム・ブロモジクロロメタン・ジブロモクロロメタン・ブロモホルム・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・1,1,1-トリクロロエタン・CAT(農薬)・2-MIB(カビ臭)・溶解性鉛
除去できない物質		水中に溶け込んでいる鉄分・重金属類(銀・銅など)や塩分(海水)
カルシウム添加		強制溶解添加方式、添加筒内蔵〔電解補助剤として〕
電源コードの長さ		約2 m
電源保護装置		電流ヒューズ：3.15 A
リモコン部電源		コイン形リチウム電池：CR2032
製造販売元		パナソニック株式会社　東京都港区西新橋２－３８－５　西新橋ＭＦビル
製造元		パナソニック株式会社　大阪府門真市大字門真1006番地

※数値は水温20℃時の値です。　※硬水を軟水に変えることはできません。
※通水量および1日の使用水量は、吐水口・排水ホースからの水量を合計したものです。

（注1）アルカリイオン水、弱酸性水、浄水で使用できる水は、ろ過流量·浄水能力の約80%に相当します。
（注2）水質・使用環境によって短くなることがあります。
（注3）JIS S 3201 試験による除去率 80 %の値。
（注4）JIS S 3201 試験によるろ過流量の 50 %の値。
（注5）1日15 L使用した場合です。1日30 L使用すると、ろ材使用限界は約半分になります。
使用水量・水質・水圧によって大幅に短くなることがあります。

別売品

お買い上げの販売店またはパナソニックの製品を扱っている販売店で購入してください。
使いかた、取り付けかたについては、それぞれに付属の説明書をよくお読みください。

（価格は2011年4月現在のものです。）

消　耗　品

●交換用カートリッジ ★

品　　番：TK7415C1
希望小売価格：9,030 円（税込）

●グリセロリン酸カルシウム製剤 ★

1　　袋：6 g入　12本
品　　番：P-A5101
希望小売価格：3,990 円（税込）
※ 付属品とは包装が異なります。

●pH試験液 ★

品　　番：TK805003
希望小売価格：630 円（税込）
（22ページ参照）

●通水路洗浄剤 ★

品　　番：PVL-P8641S
希望小売価格：1,260 円（税込）
- 添加筒や通水路の汚れや、においが気になるとき、お使いください。（36ページ参照）

●本体洗浄用カートリッジ ★

品　　番：PRA-B8641S
希望小売価格：2,100 円（税込）
- カルシウム除去専用 （36ページ参照）

壁にかけて使うとき

壁掛けセット

品　　番：TK803009
希望小売価格：3,150 円（税込）
- 取り付けは、販売店にご依頼ください。

水栓が大型のとき

大型水栓用金具（内径32.5 mm）

品　　番：P-06JR
希望小売価格：1,155 円（税込）
- 水栓先端径が24 mm～32 mmの水栓に （11ページ参照）

シンクのコーナーに設置するとき

コーナー設置台

品　　番：P-A3705
希望小売価格：2,940 円（税込）
- ご購入される場合は、販売店にご相談ください。
- **コーナー設置例**

給水ホース（長さ2.5 m）★

品　　番：TK805005〔給水·吐水一体型〕
希望小売価格：2,730 円（税込）
- 付属の給水・吐水ホース（約1.5 m）では長さが足りないときに

次ページにつづく

別売品（つづき）

排水ホース（長さ2.5 m）★

品　　番：PDB-C8616B
希望小売価格：1,050 円（税込）
- 付属の排水ホース（約1.5 m）では長さが足りないときに

※ホースの直径は付属品より大きくなります。

結露水排水ホース（長さ1.5 m）★

品　番：PDB-C8616K
希望小売価格：1,050 円（税込）
- 48ページの「本体の下から水が出る」をご参照ください。

泡沫水栓用つぎて（内ねじ用）

- 品　番：PRV-D8623K〔W23, 山20〕
- 品　番：PRV-D8623M〔W24, 山20〕
- 品　番：PRV-D8623G〔M24, ピッチ1 mm〕

希望小売価格：各 1,050 円（税込）
- 水栓メーカー・品番をご確認のうえ、販売店にご相談ください。（11ページ参照）

■ **下記の部品は、補修部品扱いです。**

固　定　具（水切換レバー取り付け用）

- **泡沫用つぎてA**※1

品　番：PRV-C8605D
希望小売価格：315 円（税込）
TOTO・INAX・MYM・KVK・カクダイ・ミズタニ製水栓用〔W22・山20〕

- **泡沫用つぎてB**※1

品　番：PRV-C6402W
希望小売価格：315 円（税込）
YANMAR・GROHE・MOEN製水栓用〔M22・ピッチ1 mm〕

- **泡沫用パッキン**

品　番：PFP-H6111
希望小売価格：105 円（税込）

※1 AまたはBの表示があります

- **取付リング〔大〕**

（ベージュ）

品　番：PRV-C8605BC
希望小売価格：210 円（税込）

- **取付リング〔小〕**

（白）

品　番：PRV-C8605AW
希望小売価格：210 円（税込）

- **取付リング用 パッキン**

品　番：PFP-H6135
希望小売価格：210 円（税込）

- **本体用パッキン**（水切換レバー装着品に同じ）

品　番：PFP-H5061
希望小売価格：105 円（税込）

- **取付金具**（ねじ4本付）

品　番：PRV-C8615M
希望小売価格：525 円（税込）

保証とアフターサービス　よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは
■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話　（　　）　－
お買い上げ日　　年　月　日

修理を依頼されるときは

「このような表示が出たときには」「故障かな？と思ったときには」（43～50ページ）でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	アルカリイオン整水器
●品　番	TK8032
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間　：　お買い上げ日から本体1年間（ただし消耗品は、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、このアルカリイオン整水器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

●商品の点検訪問について
お客様からのご相談なしに、商品およびカートリッジの点検案内をすることはありません。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください
ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電 話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-365**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は………………

パナソニック 修理ご相談窓口
電 話 フリーダイヤル 携帯・PHS OK **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

次ページにつづく

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

地区	窓口	電話番号	所在地
北海道地区	札 幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青 森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎ (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃 木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三 重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈 良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥 取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広 島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖 縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

さくいん

英字

あ行

か行

さ行

た行

は行

ま行

ら行

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC http://club.panasonic.jp/
携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

※ご愛用者登録には、CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスはWEB 限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「530#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は……

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検 長年ご使用のアルカリイオン整水器の点検を!

こんな症状はありませんか

- 電源プラグを差し込んでも何も表示しない
- 異常表示(U21～U30)を表示し、処置を行っても再度異常表示が出る
- 異常表示(H31～H34)が出る
- その他の異常や故障がある

▶ **ご使用中止**

故障や事故の防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビングビジネスユニット
〒522−8520 滋賀県彦根市岡町33番地

2012年1月1日作成(新版様式第1版) ZGS0TK80320E S0108T6012Y Ⓓ